



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

ДОГОВОР
за доставка на медицински изделия

№ 017-01-43 / 28.02.2020.

Днес,28.02.....2020 г., в гр. София, между:

1. „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД, с ЕИК 130345786, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Тотлебен“ № 21, представлявано от проф. д-р Асен Балтов, д.м - Изпълнителен директор, по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна,

и

2. „КАРДИО МЕДИКАЛ“ ЕООД, с ЕИК 201980901, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район р-н Красно село, бул. „Цар Борис III“ № 23, ет. 3, офис 1, представлявано от Александър Константинов Маджаров, в качеството му на Управител, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № РД-26-2444/31.12.2019 г. и № РД-26-76/09.01.2020 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на медицински изделия за ортопедия и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД**“, по Обособени позиции № 39, 49 и 54, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извършва периодични доставки на медицински изделия по Приложение № 1 „Спецификация към договора“, на база Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 2 („Предложение за изпълнение на поръчката“) и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 3 („Ценово предложение“), съгласно условията на настоящия договор („Договор“) и изискванията, посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приложенията са неразделна част от Договора.

(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в ал. 1 ще се нарича в Договора „**Доставка**“.



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всяка една извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доставка, съгласно единичните цени, посочени Приложение № 3. Посочените в него цени включват всички такси и други разходи във връзка с Доставката до мястото на изпълнение по чл. 3, ал. 5. Общата стойност за извършване на доставките за целия срок на Договора е 597 155,88 лева /петстотин деветдесет и седем хиляди сто петдесет и пет лева и осемдесет и осем ст./ без включен ДДС или 716 587,06 лева /седемстотин и шестнадесет хиляди петстотин осемдесет и седем лева и шест ст./ с ДДС, която включва:

1. Обособена позиция № 37 - 359 031,40 лева без включен ДДС или 430 837,68 лева /четиристотин и тридесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и шестдесет и осем ст./ с ДДС;
2. Обособена позиция № 49 - 181 174,68 лева без включен ДДС или 217 409,62 лева /двеста и седемнадесет хиляди четиристотин и девет лева и шестдесет и две ст./ с ДДС;
3. Обособена позиция № 54 - 56 949,80 лева без включен ДДС или 68 339,76 лева /шестдесет и осем хиляди триста тридесет и девет лева и седемдесет и шест ст./ с ДДС;

(2) Заплащането на възнаграждението по ал. 1 се извършва при кумулативното наличие на следните документи:

- а) подписан от страните приемателно-предавателен протокол по чл. 10, ал. 2 от Договора за съответната Доставка;
- б) предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за съответната Доставка, приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение по ал. 1 за съответната Доставка се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от изпълнението ѝ.

(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

IBAN: BG34 UNCR70001520570876

BIC: UNCRBGSF

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯт е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в данните за банковата сметка по ал. 4 в срок от три дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯт не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок или плащането е извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди получаване на уведомлението, се счита, че плащането е надлежно извършено.



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

(6) Единичните цени, посочени в Приложение № 3 не подлежат на изменение за срока на настоящия Договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) Договорът се сключва за срок от 2 (две) години, считано от датата на подписването му.

(2) В рамките на срока по ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осъществява доставките в срок до 72 (седемдесет и два) часа, считано от часа последващ часа на получаване на писмена заявка („Заявка“) от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпраща Заявката до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на адрес, факс или електронна поща:

адрес: гр. София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 23, ет. 3, офис 1

тел.: 02 / 9533616; факс: 02 / 9533616

e-mail: cardiomedical@abv.bg

Заявката може да бъде за част или за цялото прогнозно количество, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е задължен да заяви цялото прогнозно количество по време на срока на Договора. В случай, че за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е възникнала необходимост от Доставка, същият има право да не заявява количества.

(4) Договорът не обвързва **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със задължението да направи Заявка, а последната е обусловена от възникване на необходимост от Доставка за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В случай че условието по предходното изречение не е налице, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да претендира неустойки и/или каквото и да е било обезщетения за причинени вреди.

(5) Мястото на изпълнение на доставките е „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София 1606, бул. „Тотлебен“ № 21, Болнична аптека на възложителя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения всяка една от доставките, съгласно условията на Договора, Техническата спецификация и Приложение № 2;

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Заявката по Договора, относно качеството, количествата и техническите параметри, без с това да пречи на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3. да задържи/усвои съответна част от Гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на Договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел VII от настоящия Договор;



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

4. да прегледа доставената стока и да направи рекламиации при установяване на некачествена/непълна Доставка или такава, която не е в съответствие с Приложение № 1;
5. да получи Доставката в срока и при условията, договорени между Страните;
6. да не приеме Доставката и да отрази установените недостатъци/липси в приемо-предавателния протокол по чл. 10, ал. 2, в случай че Доставката не отговаря на изискванията по Приложение № 1 и условията на този Договор;
7. да прекрати Договора еднострочно по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в случай на съществено неизпълнение (по смисъла на чл. 15, ал. 2) от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 5. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение при пълно и качествено изпълнение на Доставка в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия Договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта.
2. при доставяне на стоката да я прегледа, да попълни приемателно-предавателните протоколи и при установяване на явни недостатъци или липси да ги отрази в протокола по чл. 10, ал. 2;
3. да осигури помещение за съхранение според съответните изисквания, ако има такива, на доставеното количество стоки.

Чл. 6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия Договор.
2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на Доставката по Договора и приемането ѝ, когато е изпълнена съгласно изискванията по чл. 7, т. 1.

Чл. 7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Приложение № 1 и настоящия Договор. Срокът на годност на доставяните медицински изделия следва да не е по-малък от 75% от обявения от производителя срок към датата на всяка една от доставките;
2. да съхранява и транспортира Доставката до мястото на изпълнение при спазване на посочения от производителя температурен режим и други условия за съхранение;
3. в случаите по чл. 4, т. 6, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** са задължава да замени за своя сметка Доставката с друга, отговаряща на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1.



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

№ 1 в срок до 12 (дванадесет) часа, считано от часа, посочен в протокола за некачествената/непълна Доставка. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не достави в срока по предходното изречение заменените стоки и/или доставените стоки не отговарят на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** начислява неустойка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 11, ал. 2, която се удържа от Гаранцията за изпълнение;

4. да не използва или разпространява информация за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.

Чл. 8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да продължи изпълнението на Доставката и в случай на забавяне на плащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради обективни причини.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) При сключване на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя Гаранция за изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на 11 943,12 лева (единадесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и дванадесет ст.), представляващи 2 % (два процента) от неговата обща стойност, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- а) парична сума, внесена по посочена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** банкова сметка;
- б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
- в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1.

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за частта, съответстваща на неизпълнението. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума).



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 10. (1) Приемането на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се извършва чрез Началник Болнична аптека или негов заместник. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемателно-предавателният протокол се подписва от лицето приемащо доставката, а за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – от определено от него лице.

(2) Приемането на доставка по Заявка се удостоверява с подписане от представителите по ал. 1 на двустранен приемателно-предавателен протокол, в който се отразява датата и часа на доставката, вида и броя на доставяните медицински изделия, срокът на годност, както и придружаващите ги документи. Доставката се счита приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** само ако същият е подписал приемателно-предавателния протокол без възражения (посочване на недостатъци/липси на стоки или документи, които следва да ги придружават).

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни Заявка в срока по чл. 3, ал. 2, той дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло и двадесет и пет стотни процента) от стойността на неизпълнената Заявка за всеки просрочен час, но не повече от 30% (тридесет процента) от стойността на неизпълнената Заявка.

(2) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълни Заявка некачествено и не замени Доставката в срока по чл. 7, т. 3 с друга, отговаряща на изискванията по чл. 7, т. 1 и по Приложение № 1, той дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка за всеки отделен случай в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от Заявката.

Чл. 12. Изплащането/удържането на неустойки не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

Чл. 13. При прекратяване на Договора поради отказ от доставка на медицински изделия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на заявлената, но неизпълнена доставка.





София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи/усвои неустойката от Гаранцията за изпълнение.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 14. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях наследни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Настоящият Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на предвидената в чл. 2, ал. 1 обща стойност;

2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;

3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати Договора без предизвестие в случай на съществено неизпълнение на задълженията от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За „съществено неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** забави два или повече пъти срока за доставка по Договора с повече от 48 (четиридесет и осем) часа;

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** два или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, т. 3 констатирани недостатъци/липси;

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;

4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

X. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА





София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Чл. 16. (1) Предвидените възможности за изменение на настоящия договор, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП, са следните:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца;
 2. Стойността на договора се определя като предложената цена е за изпълнение на поръчката за 6 месеца, но стойността може да се увеличи с една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора;
 3. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени;
 4. Договорената цена по договора за обществена поръчка може да се изменя на основание изменение на държавно регулирани цени, правещо невъзможно изпълнение на договора при договорените условия;
 5. В случай на цялостна или частична замяна на медицинските изделия, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните.
- (2) Настоящият договор може да бъде променян и в други случаи, но само по реда и основанията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпись на приемашата страна.


(2) За датата на съобщението се смята:

1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща – при изпращане по имейл.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на договора и предаване на документи, се смятат:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД

гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, Болнична аптека, тел.: 02 9154-581,
e-mail: svetozar.petrov@pirogov.bg, Ръководител Болнична аптека.

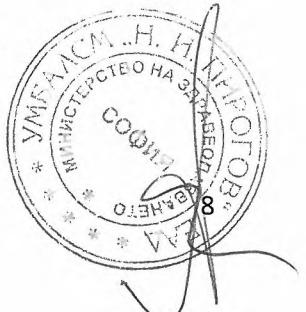



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

2. За изпълнителя: „КАРДИО МЕДИКАЛ“ ЕООД

адрес: гр. София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 23, ет. 3, офис 1

тел.: 02 / 9533616; факс: 02 / 9533616

e-mail: cardiomedical@abv.bg

Чл. 18. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

(2) В случай на преобразуване, вливане или сливане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, юридическите лица, техни правоприемници, са обвързани със задълженията по този договор при спазване изискванията на ЗОП.

Чл. 19. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между Страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 20. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


Чл. 21. Неразделна част от настоящия Договор са:

1. Приложение № 1- „Спецификация към договора“;

2. Приложение № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3. Приложение № 3 - „Ценово предложение“ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Договор се склучи в два еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.




ЗАЛИЧЕНИ на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Обособена позиция 37

№	Описание	Марка	Противозо ко количество за две календарни години /бр./	Търговско наименование	Каталожен номер	Производител	Г. производ.	Обща стойност
1	Промонтиран стент за коронарна ангиопластика (материал : кобалт-хромиева сплав L605). Структурен дизайн - тип затворена клемка,карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина 0.3 им, определящ бионидуцираща повърхност на стента. Дебелина на стратовете - 70 - 80 им. 2 платинени рентгенопозитивни маркери за предизвикане и маркиране. Проектирана стомана с РГЕ покритие - 1.78F за стентове с диаметър 2.25 mm - 2.75 mm; 1.9 за стентове с диаметър 3.0 mm - 4.5 mm. Дистален шафт - 2.7F от полимид и пебакс. Балон - катетър - полуразтеглив, от полидиамид, с хидрофилно покритие, с 2 маркера. Размери: диаметър - от 2.25 mm до 4.5 mm; дължина - от 7 mm до 31 mm /за стентове с диаметър от 3.0 mm до 4.5 mm/.	бр.	50					
2	Медикамент - излучващ стент /материал: кобалт - хрониева сплав L605/. Структурен дизайн - мултиплочен стройк с вградени в стратовете абунинали резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента - актинфиникс модел /сиорникамус + органична киселина/ само в посока съдовата стена. Свободна от полимер повърхност: дебелина на стратовете - 80 им. Карбоново покритие на тънък слой с дебелина 0.3 им, определящ бионидуцираща повърхност на стента 2 рентгенопозитивни маркера за предизвикане и маркиране. Съдържа 5 F водещ катетър и 0.014" водач. Размери: диаметър - 2.25 mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm и 4.5mm; дължина - 8 mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31mm, 38 mm и 46mm /за стентове с диаметър 2.5 mm, 2.75mm, 3.0mm и 3.5mm/ .	бр.	100					
3	Промонтиран ендопаскуларен стент за антиопластична на интималия и артерии. Материал: кобалто-хромиево покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина 0.3им, определящ бионидуцираща повърхност на стента.Структурен дизайн - мултиплочен стройк. Дебелина на стратовете - 0.175 mm. Два рентгенопозитивни маркера от платина за превишено позициониране.Размери : диаметър - от 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm; дължина - 19mm,29mm, 39mm ; за стентове с диаметър 6 mm и 10 mm - 19mm,29mm и 39mm/ ,съвместим с бг водещ катетър и 0.035" водач. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, сънаг на шест от полимид. OTW тип. Полезна дължина на катетъра - 75 см или 135 см.	бр.	50					
4	Промонтиран ендопаскуларен стент за ангиопластика на ренални артерии. Материал: карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина 0.3им. Структурен дизайн - тип затворена клемка: с коногенен клепачен дизайн за стентове с дължина 12 mm и мултиплочен дизайн за стентове с дължина 17 mm. Опредално електроподхране на повърхността на стента. Рентгенопозитивни платинени маркери за предизвикане и маркиране. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, сънаг на шест от полимид. Rapid Exchange тип. Плюснилан шафт - 3.5F, с дължина - 25 см. Съвместим с 5 F водещ катетър и 0.018" водач. Размери: диаметър - от 5.0 mm до 10.0 mm, дължина - 12 mm и 17 mm. Големина дължина на сънага разтегващ - 75 см и 150 см.	бр.	20					
5	Сънага разтегващ се ендопаскуларен стент за ангиопластика на интималия и SFA. Материал: интималия, карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина 0.3им. Структурен дизайн - хибриден катетъчен стройк дебелина на стратовете - 0.190 mm за стентове с диаметър 6mm, 7mm и 8mm, 0.220mm за стентове с диаметър 9 mm,10 mm и 12mm. Шест танталови рентгенопозитивни маркери за предизвикане и маркиране /от 6 mm до 8 mm и от 20 до 100 mm / за стентове с диаметър от 6 mm до 12 mm, дължина - от 20 до 150 mm / за стентове с диаметър от 9 mm до 12 mm / Система за доставяне, включваща катетър с вътрешен линен - OTW тип, съвместим с бг интродюсер и 0.035" водач, с полезна дължина 85 см или 135 см и ергономична държка, позволяваща манипуляция с един ръка и обезопасявайки катетър, предотвратяващ пренадвременното освобождаване на стента.Два механизма за разтегване и освобождаване на стента - посредством колело-бутон или приспособление за издръждане за бурло освобождаване.	бр.	50					
6	Промонтиран покрит стент за периферна ангиопластика.Материал на стента - неръждаема стомана 316L. Структурен дизайн - тип отворена клемка. Film Cast Encapsulation технология на покритие. Материал на покрийте /Микро поресто / 100 - 120 микрона / РГЕ под формата на ултраТМ катетър или слой, обхващащ двустранно и цялото стратове на стента, за предизвикане на тъжкото прораставане."Powerstirr" технология за контролирано единогатично освобождаване. Иновативна гермоизолационна технология на флуорополимерното покритие - опция за допълнително разтегтане на лакирана прокладка слой, даваща възможност за пост-дилатация на всички размери до диаметър 12mm. Два златни рентгенопозитивни маркера за предизвикане и маркиране. Диаметър - 5 mm, балон 7mm, 8mm, 9mm, 10mm ; дължина - 16mm, 22mm, 38mm, 59mm, Съвместим с 7/7 интродюсер и 0.035" водач Балон - катетър - от политетилен терфрагат, неразтеглив. Полезна дължина на системата - 80 см и 120 см.	бр.	30					

7	Периферен медициамент - излучващ стент / материал : нобалт - хрониева сплав L605 / за антиопластика на подколенни артерии. Структурен диаметър 1,6мм, дължина 100мм, с профил на върха 0,017" и катетър 1Х - тип, с дължина 142 см, съвместим с 0,014" водач, 4F интродюсер и 5F водещ катетр. Мултиклъчен стомек с вградени в стомека обхумилни разширители за контролирано и насочено освобождаване на медицангента - анфилинкус модел / сиролимис + органнична киселина / само в посока сърдата стена. Свобода от полимер покъркност. Дебелина на стомека 70 - 80 мкм, карбоново покритие на стомека - 100% чист вълнепод под / формата на тънки слой / дебелина на покрило 0,3 мкм, определящо бионидизра повърхност на стента. Две платинови рентгенопактивни маркери за преминаване и позициониране. Размери : диаметър - 2,25мм, 2,5мм, 3,0мм, 3,5мм, 4,0мм, 4,5мм; дължини - 8мм, 12мм, 16мм, 20мм, 25мм, 31мм, 38мм и 45мм / за стомека с диаметър от 2,5мм, 2,75мм, 3,0мм и 3,5мм / Доставяща система, включваща балон от от поликлими, с два маркера, с профил на върха 0,017" и катетър 1Х - тип, с дължина 142 см, съвместим с 0,014" водач, 4F интродюсер и 5F водещ катетр.	бр. 100		
8	Саморазтварящ се ендодолгунчален стент - графт / покрит стент / за периферна антиопластика. Материал на стента : нитинол. Материал на покритие: дватънни спом еПТФ / алуминиев и луминиев, обхващащи двустранно и идиално съртавите на стента. Пътинален еПТФ слой - покрит с карбон. Осем танталови рентгенопактивни маркери за преминаване и позициониране - по 4 в двете края / Структурен диаметър - тип отвора клепка - 4мм в крашата за предотвратяване на имиграция на стента. Съвместим с 8, 9 и 10F интродюсер и 0,035" водач. Размери - диаметър - 5мм, балон - 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 12мм и 13,5мм, дължина - 20мм / за стент графт с диаметър от 5мм до 8мм / 3Дим, 40мм, 50мм, 60мм, 80мм, 100мм, 120мм. Полезна дължина на системата - 80см или 117см.	бр. 30		
9	Периферен балон - катетър за антиопластика на кипачни артерии, обхуканиви лезини на матини или синтетични артериопензини, дългиани фисури и постнатмация на префериран стентове или стент-графтове. Тип - неразтеглив / пол-compliant / OTW, съвместим с 0,035" водач и 7-12F интродюсер. Номинално налягане на раздължне - 4-6 Атм. Най-голямо на разтегдане - 12-18 Атм. Шарък дигласи на работното налягане - от 6 до 18 Атм / за балон - катетери с размер 1Дим. х 40мм / Кеси рамена на балона - 21мм / за балони с размер 18мм х 40мм. Размери - диаметър - 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22, 24мм или 26мм. Дължина - 20мм, 40мм или 60мм. Полезна дължина на системата - 80см или 120см.	бр. 30		
10	Балон - катетър за периферна антиопластика. Материал на балона - полидимид. Тип - полузатеглив. Два платинени рентгенопактивни маркера за преминаване. Гъвкови точки Слесър, които подобряват преминаване на балона при сърдечно извити съдове. Двойно интродуцирано покритие на балона - вътрешен устиков слой и външен лубрикант слой, позволяващи начинаване на тръмено / Подсилен в тръмено лукс, позволяващ преминаването през сърдечно стеснени съдове. Доставяни катетър - OTW - тип, двуплечен, съвместим с 4F - 6F интродюсер 0,018" водач. Размери : диаметър - 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 3,5мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 7,0мм, 8,0мм и 9,0мм; дължина - 20мм, 40мм, 60мм, 80мм, 100мм, 120мм, 250мм и 300мм . Полезна дължина на системата - 75см, 130 см и 150 см.	бр. 100		
11	Инфлационно устройство за високо налягане до 40 Атм. За раздуване, монтиране на налягане и отпускане на дилатационни балон-катетри за антиопластика. Собър: 10мл. Устройството включва заключваща лост, чанометър, еврозвещ, шланг за високо налягане, въртилка се-дентер и гръден кран за високо налягане.	бр. 50		
12	Периферен опорен и преминаващ катетър за преминаване през стоменични лезини, окулации и малки съдове, улесняване сърдца на водачи и разширяване на инфузийни разтовари и контрастни вещества. Маркери с дължина 1 см, разположени по протежение на дисталните 30 см от дължината на катетъра. Двойни маркери на дължина 10см и 20см от върха на катетъра. Вграден 1мм платинен рентгенопактивен маркер на разстояние 5-6мм от върха. Съвместим с 0,014", 0,018" и 0,035" водач и 4F и 5F интродюсер. Профил на преминаване на върха - 0,017" / за 0,014" катетър / Дължина - 65см, 90см, 135см и 150см.	бр. 100	Общо:	

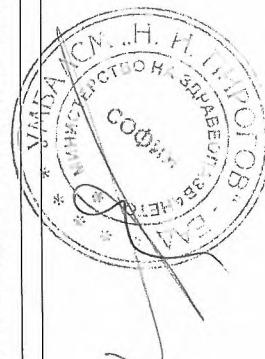


Позиция 49. Дискретни протези за съдови хипоприя

#	Описание	Марка	Прототип количесто ка лекарстви	Търговско наименование	Код ложки помер	Производител	Бр. цена	Оптич стопанс
1	Дакронона , плетена, прана със съдова пръска, покрита с колаген и импрегнирана със сребричен агент, /с отделине до 30-ия ден/, "Reverse Locknit" оплека, само пънчен пелур. 6,78 мм - 40 см	бр.	15					
2	Дакронона, бидурациона съдова пръска, покрита с колаген и импрегнирана със сребричен агент /с отделине до 30-ия ден/, "Reverse Locknit" оплека, само пънчен пелур. 12x6,14x7,16x8,18x9,20x10,22x11,24x12 мм - 50 см	бр.	15					
3	Дакронона, плетена, прана съдова пръска, покрия с колаген и импрегнирана със сребричен агент и антибиотик Triclosan, /с отделине до 30-ия ден/, "Reverse Locknit" оплека, само пънчен пелур, с размери 6,78 мм и дължина 40 см	бр.	15					
4	Дакронона, плетена, бидурациона съдова пръска, покрия с колаген и импрегнирана със сребричен агент и антибиотик Triclosan, /с отделине до 30-ия ден/, "Reverse Locknit" оплека, само пънчен пелур, с размери 12x6, 14x7, 16x8, 18x9, 20x10, 22x11, 24x12 мм - 50 см	бр.	15					
5	Дакронона , плетена, прана съдова пръска, покрия с колаген, "Reverse Locknit" оплека, обезжелана на стена 0,49 мм, само пънчен пелур. 6,78 мм - 40 см	бр.	70					
6	Дакронона, бидурациона съдова пръска, покрия с колаген, "Reverse Locknit" оплека, обезжелана на стена 0,49 мм, само пънчен пелур, 12x6,14x7,16x8,18x9,20x10,22x11,24x12 мм - 50 см	бр.	12					
7	Дакронона , плетена, прана съдова пръска, покрия с колаген и импрегнирана с хепарин, гликосептина - 0,39 мм, само пънчен пелур. 6,78 мм - 40 см	бр.	4					
8	Бидурациона пръска, с колаген и хепарина импрегнирана, само пънчен пелур. 12x6,14x7,16x8, 18x9,20x10,22x11 мм - 50 см	бр.	4					
9	Прани пръстен РТБЕ, стапаратда делупла на стена 0,68 / и маркпронка 6,7,8 мм - 40 см	бр.	20					
10	Прани пръстен РТБЕ с карбонпират лумен, с стапаратда лебелта на стена / 0,68 /6,7,8 мм - 40 см	бр.	20					
11	Прана съдова пръска, изработена от полихлоропрен, уредана в линии и стена преградена от пън слюо, съзиждоства на стандартен типмер АУ достъп без ринг с размери 6 мм - 20,30,40 см, U - обратен АУ достъп с оптик централно разположен ринг или не-централно разположен ринг; U - обратен АУ достъп; с дланетир 6 мм, дължина - 35 см или 40 см, дължина на ринга - 8 см.	бр.	30					
12	Заплатки каротонди 6,8,10,12,14 мм x 75 мм, гънко сцепни - 0,41 мм, "Reverse Locknit" оплека	бр.	30					
13	Ембоди - екстрактор катети 2,3,4,5,6F - 80 см, единобойни, единоразови	бр.	150					
14	Комплекти за неострингинг инструменти : метални джено с ГЕИ покриви, с дължина 100 см; 4 гланци от поликарбонат с диаметър 60мм, 70мм и 15 мили и дръжка от поликарбонат.	бр.	100					Общо:

Позиция 54 - Ангиографски консуматив

#	Описание	Марка	Прототипо ко количество за дне календарни години	Търговско наименование	Категории помер	Производи еъ	Ед. цена	Обща стоиност
1	Премонтиран ендоласкуларен стент за ангиопластика на инфарктни артерии. Материал на стента : кобалт - хром L 605. Сарофилм технология / чист титлерод / на покритие на стента под формата на тинък филм с дебелина ≤ 0.34м. Структурен дизайн - тип затворена клемка. Дебелина на стратите - 175 μ m. Отделано електрополидране на повърхността на стента. 2 рентгенопозитивни маркера от пластина за пречистване поизползвани. Съвместим със бГ водещ катетър и 0.035" носци. Носци блон - катетър: полуразтеглив, сънят на шест, от полидамил. OTW тип. Размери на стента: Диаметър от 6 до 10 mm и дължина от 19 до 59 mm.	бр.	40					
2	Премонтиран ендоласкуларен стент за ангиопластика на инфарктни артерии. Материал: кобалт - хром L 605. Сарофилм технология на покритие на стента от тинък филм с дебелина ≤ 0.3 μ m. Структурен дизайн - тип затворена клемка, дебелина на стратите 70 μ m / за 2.25 - 2.75 mm / или 80 μ m / за 3.0 - 4.5 mm / Стимулодалин интерконекторни връзки. Огледално електрополидране на повърхността на стента. 2 рентгенопозитивни пластинени маркера за пречистване поизползвани. Носци блон - катетър: от пебакс / за 2.25 - 2.75 mm / или полидамил / 3.0 - 4.5 mm / Rapid Exchange тип, с ComfortCoat хидрофилно покритие. Съвместим с 4F водещ катетър и .014" водач. Размери - диаметър - от 2.25mm до 4.5mm, дължина - от 7mm до 31mm.	бр.	10					
3	Саморазграждащ се ендодумпилан стент за периферна ангиопластика. Материал : нитилпол.8 танталови рентгенопозитивни маркери за пречистване поизползване / по 4 в дната края /. Допълнителен маркер върху носцета система, на 6 mm от дисталния край, поизползване пречистване проследяване на имплантането на стента. Контролиран механизъм с 4 опции за освобождаване на стента - спусъков, пътланчен, комбиниран и концептуален. Структурен дизайн - тип отпорна клемка. Изразянни участъци от 2 mm в краишата за предотвратяване на миграция на стента. Съвместим с 8F водещ катетър бГ производител 0.035" носци. Размери - диаметър - 4 до 14 mm, дължина - от 20 до 120 mm.	бр.	30					
Общо:								

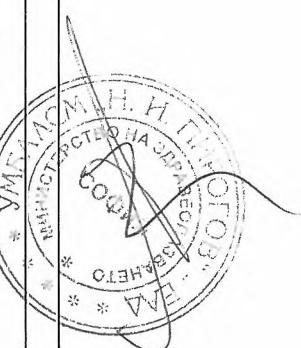

КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД

Бул. "Цар Борис III" № 23
София 1612 тел./факс: 02 953 3616

e-mail: cardiomedical@abv.bg

Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

От "Кардио Медикал" ЕООД (наименование на участника) с ЕИК 201980901 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установлен), представявано от Александър Константинов Маджаров (имената на законния или упълномощен


заличени на основание чл. 3 ба., ал. 3 от ЗОП.

хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

1. Участваме за обособена позиция № 37 / Раздел Инвазивна кардиология

Но мер на ном ен- кла тур а	Изисквания на възложителя		Предложения на участника		
	Описание	Опаковка/ Мерна единица	Търговско наименование	Производ ител	Други особености по преценка на изпълнителя
1	2	3	4	5	6
1	Премонтиран стент за коронарна ангиопластика (материал : кобалт-хромиева сплав L 605). Структурен дизайн - тип затворена клетка. Карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на	брой	Avantgarde Chrono Carbstent	CID S.p.A.	

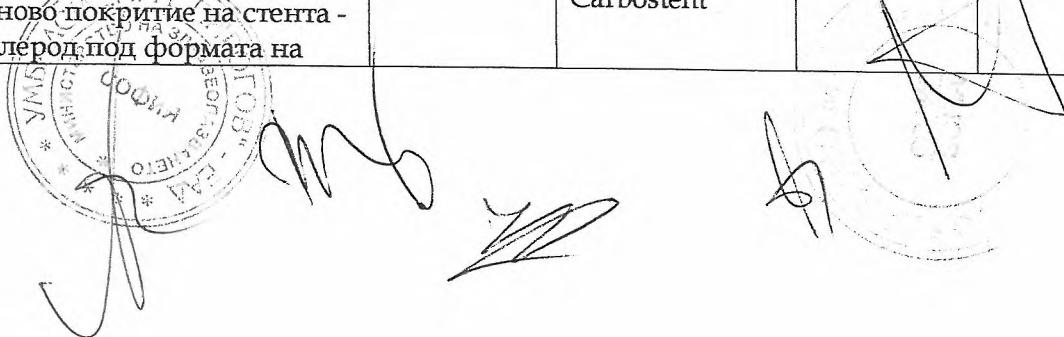


	<p>тънък слой с дебелина ≤ 0.3 μм, определящо биоиндуцираща повърхност на стента. Дебелина на стратовете - 70 - 80 μм. 2 платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране.</p> <p>Проксимален шафт -hypotube от неръждаема стомана с PTFE покритие - 1.78F за стентове с диаметър 2.25 mm - 2.75 mm; 1.9 за стентове с диаметър 3.0 mm - 4.5 mm. Дистален шафт - 2.7F от полиамид и пебакс. Балон - катетър - полуразтеглив, от полиамид, с хидрофилно покритие, с 2 маркера. Размери: диаметър - от 2.25 mm до 4.5 mm; дължина - от 7 mm до 31 mm / за стентове с диаметър от 3.0 mm до 4.5 mm/.</p>			
2	<p>Медикамент - изльчващ стент /материал: кобалт - хромиева сплав L605/. Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени в стратовете аблуминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента - амфилимус модел /сиролимус + органична киселина/ само в посока съдовата стена. Свободна от полимер повърхност. Дебелина на стратовете - 80 μм. Карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3 μм, определящо биоиндуцираща повърхност на стента. 2 рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Съместим с 5F водещ катетър и 0.014" водач. Размери: диаметър - 2.25 mm, 2.5mm, 2.75mm,3.0mm,3.5mm,4.0mm и 4.5 mm; дължина - 8 mm, 12mm,16mm,20mm,25mm,31mm, 38 mm и 46mm / за стентове с диаметър 2.5 mm ,2.75mm,3.0mm и 3.5mm /.</p>	брой	CRE8	CID S.p.A.
3	<p>Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии / материал : кобалт - хромиева сплав L605 /. Карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3μм, определящо биоиндуциращата повърхност на стента.Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж. Дебелина на стратовете - 0.175 mm. Два рентгенопозитивни маркера от платина за прецизно позициониране.Размери : диаметър - от 6.0mm, 7.0mm,8.0mm,9.0mm,10.0mm; дължина -</p>	брой	Isthmus Logic Carbostent	CID S.p.A.

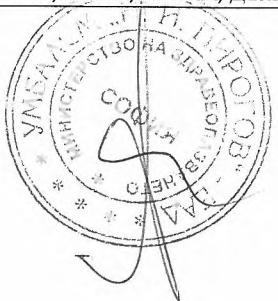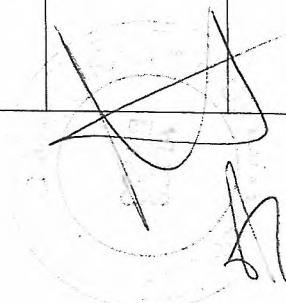
	19мм,29мм,39мм, 49мм,59мм / за стентове с диаметър 6.0мм и 10.0мм - 19мм,29мм и 39мм/, съвместим с 6F водещ катетър и 0.035" водач. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, сгънат на шест, от полиамиид, OTW тип. Полезна дължина на катетъра - 75см или 135 см.			
4	<p>Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на ренални артерии. Материал: неръждаема стомана. Карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3μm. Структурен дизайн - тип затворена клетка; с хомогенен клетъчен дизайн за стентове с дължина 12 mm и мултиклетъчен дизайн за стентове с дължина 17 mm.</p> <p>Огледално електрополиране на повърхността на стента. 2 рентгенопозитивни платинени маркери за прецизно позициониране. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, сгънат на шест, от полиамиид, Rapid Exchange тип.</p> <p>Проксимален шафт - 2.3F, дистален шафт - 3.5F, с дължина 25 см. Съвместим с 5F водещ катетър и .018" водач. Размери: диаметър - от 5.0 mm до 7.0 mm; дължина - 12 mm и 17 mm. Полезна дължина на системата - 75 см и 150 см.</p>	брой	Radix2 Carbostent	CID S.p.A.
5	<p>Саморазгъващ се ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии и SFA. Материал : нитинол. Карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3μm. Структурен дизайн - хибриден клетъчен строеж. Дебелина на стратовете - 0.190 mm за стентове с диаметър 6mm,7mm и 8mm; 0.220mm за стентове с диаметър 9 mm,10 mm и 12mm. Шест танталови рентгенпозитивни маркери за прецизно позициониране / по три в двета края на стента/. Размери - диаметър - от 6 до 12 mm, дължина - от 20 до 150 mm / за стентове с диаметър от 6mm до 8mm / и от 20 до 100 mm / за стентове с диаметър от 9mm до 12mm / . Система за доставяне, включваща катетър с вътрешен лumen - OTW -тип, съвместим с 6F интродюсер и 0.035" водач, с полезна дължина 85 см или 135 см и ергономична дръжка, позволяваща манипулация с една ръка и обезопасяващ ключ, предотвратяващ преждевременното освобождаване на стента.Два механизма за разгъване и освобождаване на стента - посредством колело-бутон или приспособление за издързване за бързо освобождаване.</p>	брой	Easy FLYPE / HIFLYPE Carbostent	CID S.p.A.




	Премонтиран покрит стент за периферна ангиопластика. Материал на стента - неръждаема стомана 316L. Структурен дизайн - тип отворена клетка. Film Cast Encapsulation технология на покритие. Материал на покритие - микропоресто / 100 - 120 микрона / PTFE под формата на ултратънък ламириращ слой, обхващащ двустранно и изцяло стратовете на стента, за предотвратяване на тъканното прорастване. "Powercrimp" технология за контролирано едноетапно освобождаване. Иновативна термоадаптационна технология на флуорполимерното покритие - опция за допълнително разтягане на ламиниращият слой, даваща възможност за пост-дилатация на всички размери до диаметър 12мм. Два златни рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Диаметър - 5 mm ,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm ; дължина - 16mm,22mm,38mm,59mm. Съвместим с 6/7F интродюсер и 0.035" водач. Балон - катетър - от полиетилен терефталат, неразтеглив. Полезна дължина на системата - 80cm и 120 см.	брой	ADVANTA V12 Vascular Covered Stent	Atrium Medical Corp.
7	Периферен медикамент - излъчващ стент / материал : кобалт - хромиева сплав L605 / за ангиопластика на подколенни артерии. Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени в стратовете аблюминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента - амфилимус модел / сиролимус + органична киселина / само в посока съдовата стена. Свободна от полимер повърхност. Дебелина на стратовете 70- 80 μm. Карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3μm, определящо биоиндуцираща повърхност на стента. Два платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Размери : диаметър - 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm,3.0mm,3.5mm, 4.0mm, 4.5mm; дължина - 8mm, 12mm,16mm,20mm,25mm,	брой	CRE8 ВТК	CID S.p.A.

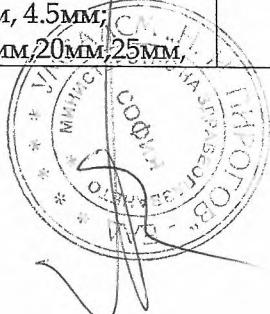

	31мм,38мм и 46мм / за стентове с диаметър от 2.5мм, 2.75мм,3.0мм и 3.5мм /. Доставяща система, включваща балон от от полиамид, с два маркера, с профил на върха 0.017" и катетър, RX - тип, с дължина 142 см, съвместим с 0.014" водач, 4F интродюсер и 5F водещ катетър.			
	Саморазгъващ се ендолуминален стент - графт / покрит стент / за периферна ангиопластика .Материал на стента : нитинол. Материал на покритие: два тънки слоя еПТФЕ / алуминален и луминален/, обхващащи двустранно и изцяло стратовете на стента.Луминален еПТФЕ слой - покрит с карбон.Осем tantalови рентгенпозитивни маркери за прецизно позициониране / по 4 в двета края /.Структурен дизайн - тип отворена клетка. Непокрити участъци от 2 мм в краишата за предотвратяване на миграция на стента.Съвместим с 8, 9 и 10F интродюсер и 0.035" водач. Размери - диаметър- 5мм,6мм,7мм,8мм,9мм,10мм,12мм и 13.5 мм, дължина - 20мм / за стент графт с диаметър от 5мм до 8мм /,30мм,40мм,50мм,60мм,80мм,100мм, 120 мм. Полезна дължина на системата - 80см или 117 см.	брой	E - Luminexx Vascular Stent	Angiomed GmbH /собствен ост на BARD/
9	Периферен балон - катетър за ангиопластика на илиачни артерии, обструктивни лезии на нативни или синтетични артериовенозни диализни фистули и постдилатация на преферни стентове или стент-графтове. Тип - неразтеглив / non-compliant /, OTW, съвместим с 0.035" водач и 7- 12F интродюсер. Номинално налягане на раздуване - 4-6 Атм. Налягане на разкъсване - 12-18 Атм.Широк диапазон на работното налягане - от 6 до 18 Атм / за балон - катетри с размер 14мм x 40мм /. Къси рамена на балона - 21мм / за балони с размер 18мм x 40мм . Размери - диаметър - 12мм, 14мм, 16мм,18мм,20мм,22,,24мм или 26мм. Дължина - 20мм,40мм или 60мм. Полезна дължина на системата - 80см	брой	Ultraverse 035 PTA Balloon Dilatation Catheters	BARD



	или 120 см.			
10	Балон - катетър за периферна ангиопластика. Материал на балона - полиамид . Тип - полуразтеглив. Два платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Гъвкави точки Checker, които позволяващи преминаване на балона при силно извити съдове. Двойно хидрофилно покритие на балона - вътрешен устойчив слой и външен лубрикантен слой, позволяващ намаляване на триенето . Подсилен вътрешен лumen, позволяващ преминаването през силно стеснени съдове. Доставящ катетър - OTW - тип, двулучменен, съвместим с 4F - 6F интродюсер и 0.018" водач. Размери : диаметър - 2.0мм, 2.5мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм, 5.0мм, 6.0мм, 7.0мм, 8.0мм и 9.0мм; дължина - 20мм, 40мм, 60мм, 80мм, 100мм, 150мм, 200мм, 250мм и 300мм . Полезна дължина на системата - 75см, 130 см и 150 см.	брой	BARD Ultraverse 018 PTA Balloon Dilatation Catheters	
11	Инфлационно устройство за високо налягане до 40 Атм. За раздуване, мониториране на налягане и отдуване на дилатационни балон-катетри за ангиопластика. Обем: 30мл. Устройството включва заключващ лост, манометър, свързващ шлаух за високо налягане , въртящ се адаптер и трипътен кран за високо налягане.	брой	BARD Presto Inflation Device	
12	Периферен опорен и преминаващ катетър за преминаване през стенотични лезии, хронични тотални оклузии и малки съдове; улесняване смяна на водачи и въвеждане на инфузионни разтвори и контрастни вещества. Маркери с дължина 1 см, разположени по протежение на дисталните 30 см от дължината на катетъра. Двойни маркери на дължина 10см и 20см от върха на катетъра. Вграден 1мм платинен рентгенопозитивен маркер на разстояние 5-6мм от върха. Съвместим с 0.014"; 0.018" и 0.035" водачи и 4F и 5F интродюсер. Профил на преминаване	брой	BARD Seeker Crossing Support Catheter	

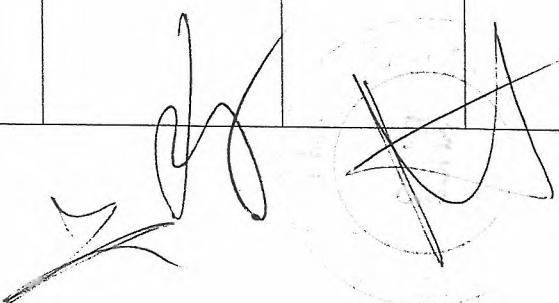

Дж

	на върха - 0.017" / за 0.014" катетър /. Дължина - 65см, 90см, 135см и 150см.			
--	--	--	--	--

2. Прилагаме оторизационни писма на името на участника от:

а/ производителя на съответните медицински изделия и консумативи или
б/ от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно
за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е
упълномощен да участва от свое име в настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка със съответните изделия на производителя – заверено от
участника копие.

3. Прилагаме сертификати за качество и декларация за съответствие на
оferираните медицински изделия и консумативи съгласно изискванията на
чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "CE" маркировка, в съответствие с изискванията
на чл.15 от ЗМИ – заверено от участника копие (посочва се за коя
номенклатурна единица се отнасят).

4. Прилагаме проспекти на български език с всички технически показатели и
параметри на предлаганите медицински изделия и консумативи и указания за
употреба.

5. Предлагаме срок на доставка на медицинско изделие - до 72 (седемдесет и два)
 часа след подадена от възложителя писмена заявка за доставка, освен в случаите,
 когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на
 доставка, различен от обявения (предлаганият срок не следва да е по-дълъг от 72
 часа).

6. Към момента на доставянето на медицинско изделие ще е със срок на годност не
по-кратък от 70 % от срока на годност, даден от неговия производител, освен в
 случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за
 срок на годност, различен от обявения.

7. Представляваното от мен дружество/обединение – се задължава да изпълни
 предмета на обществената поръчка в съответствие с всички действащи
 нормативни актове, чието спазване е необходимо:


1. за качественото изпълнение на поръчката, както и
2. за изпълнение на всички задължения, свързани с данъци и
 осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
 условията на труд, когато е приложимо.

8. Декларирам,¹ че действителният собственик по смисъла на §2, ал.1 от ДР на
 ЗМИП на представляваното от мен дружество е следното физическо лице:

1. Александър Константинов Маджаров,

заличени на основание чл.3ба, ал. 3 от ЗОП.

¹ Когато участникът е обединение/консорциум, всички съдружници в обединението/консорциумът посочват
 кои са действителните собственици на техните дружества в отделни декларации към Техническото
 предложение.

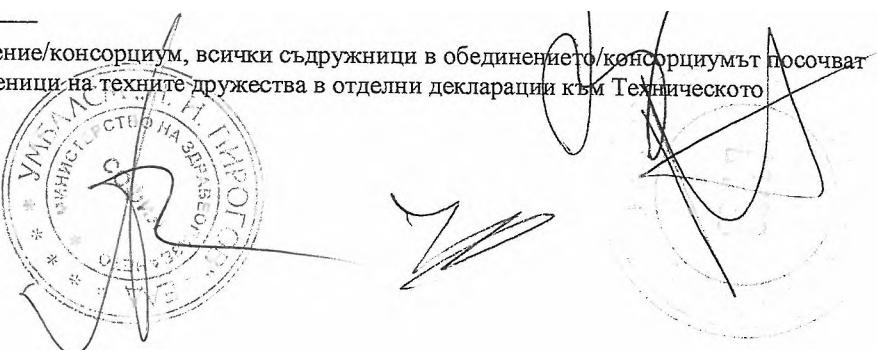

заличени на основание чл.3ба, ал. 3 от ЗОП.

- основната дейност на дружеството е търговия на едро с медицински изделия

паричните средства за изпълнение на обществената поръчка съгласно ценовото ни предложение и за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка имат следния произход: търговия на едро с медицински изделия и кредитна линия за гаранции в Уникредит Булбанк АД

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

10. Декларирам, че сме съгласни да получаваме протоколите, решенията, писмата и други документи от Възложителя на електронната поща, която сме посочили в еЕДОП.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

дата

30.08.2019 г.

Име и фамилия

Подпись на лицето (и печат)



² Когато участникът е обединение, тази декларация се подписва от съдружника в обединението, който ще внесе гаранцията за изпълнение на договора, а когато гаранцията за участие се внася от трето лице - декларацията се подписва от него.



КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД

Бул. "Цар Борис III" № 23
София 1612 тел./факс: 02 953 3616

e-mail: cardiomedical@abv.bg

Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

От "Кардио Медикал" ЕООД (наименование на участника) с ЕИК 201980901 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установлен), представлявано

заличени на основание чл. Зба., ал. 3 от ЗОП.


"**Доставка на медицински изделия за ортопедия и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД**
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

1. Участваме за обособена позиция № 49 Дакронови протези за съдова хирургия /Раздел Съдова хирургия

Чо мер на ном ен- кла тур а	Изисквания на възложителя		Предложения на участника		
	Описание	Отпаковка/ Мерна единица	Търговско наименование	Производ ител	Други особено сти по оцен ка на изпълн ителя
1	2	3	4	5	6
1	Дакронова , плетена, права съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана със сребърен ацетат, /с отделяне до 30-тия ден /,"Reverse Locknit" оплетка,само външен велур, 6,7,8 мм - 40 см	брой	InterGard Silver, Antimicrobial Knitted Straight Collagen Coated Vascular Prosthesis	InterVascu lar SAS	
2	Дакронова, бифуркационна съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана със сребърен ацетат /с отделяне до 30-тия ден /, "Reverse	брой	InterGard Silver, Antimicrobial Knitted Bifurcated	InterVascu lar SAS	

	Locknit" оплетка, само външен велур, 12x6,14x7,16x8,18x9,20x10,22x11,24x12 мм - 50 см		Collagen Coated Vascular Prostheses		
3	Дакронова, плетена, права съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана с сребърен ацетат и антибиотик Triclosan , /с отделяне до 30-ден /, "Reverse Locknit" оплетка, само външен велур, с размери 6,7,8 мм и дължина 40 см	брой	InterGard Synergy, Antimicrobial Knitted Straight Collagen Coated Vascular Prostheses	InterVascular SAS	
4	Дакронова, плетена, бъфуркационна съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана с сребърен ацетат и антибиотик Triclosan , /с отделяне до 30-ден /, "Reverse Locknit" оплетка, само външен велур, с размери 12x6, 14x7, 16x8, 18x9, 20x10, 22x11, 24x12 мм - 50 см	брой	InterGard Synergy, Antimicrobial Knitted Bifurcated Collagen Coated Vascular Prostheses	InterVascular SAS	
5	Дакронова , плетена, права съдова протеза, покрита с колаген , "Reverse Locknit" оплетка, дебелина на стената 0.49 мм, само външен велур, 6,7,8 мм - 40 см	брой	InterGard Knitted Vascular Prostheses Straight	InterVascular SAS	
6	Дакронова, бифуркационна съдова протеза, покрита с колаген , "Reverse Locknit" оплетка,дебелина на стената 0.49 мм, само външен велур, 12x6,14x7,16x8,18x9,20x10,22x11,24x12 мм - 50 см	брой	InterGard Knitted Vascular Prostheses Bifurcated	InterVascular SAS	
7	Дакронова , плетена, права съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана с хепарин, тънкостенна - 0.39 мм ,само външен велур, 6,7,8 мм - 40 см	брой	InterGard Knitted Heparin Ultrathin Straight, Collagen Coated & Heparin Bonded Vascular Prosthesis	InterVascular SAS	
8	Бифуркационна протеза, с колаген и хепаринова импрегнация, само външен велур, 12x6,14x7,16x8, 18x9,20x10,22x11 мм - 50 см	брой	InterGard Knitted Heparin Bifurcated, Collagen Coated & Heparin Bonded Vascular Prosthesis	InterVascular SAS	X
9	Прави протези PTFE, стандартна дебелина на стената / 0.68 / и маркировка 6,7,8 мм - 40 см	брой	ADVANTA PTFE Vascular Grafts	Atrium Medical Corporation	
10	Прави протези PTFE с карбонизиран лumen, с стандартна дебелина на стената / 0.68 / 6,7,8 мм - 40 см	брой	ADVANTA PTFE Vascular Grafts	Atrium Medical Corporation	
11	Права съдова протеза, изработена от поликарбонови уретанови нишки и стена изградена от пет слоя, с възможност за стандартен линеарен	брой	AvFlo Vascular Access Grafts	NICAST Ltd.	



A handwritten signature or mark consisting of several loops and lines, appearing to be a stylized 'Z' or a similar character, is written across the bottom right corner of the table.

	AV достъп без ринг с размери 6 мм - 20,30,40 см, U - образен AV достъп с опции централно разположен ринг или не-централно разположен ринг за J - образен AV достъп; с диаметър 6 мм; дължина - 35 см или 40 см; дължина на ринга - 8 см.				
12	Заплатки каротидни 6,8,10,12,14 мм x 75 мм, тънкостени - 0.41мм, "Reverse Locknit" оплетка	брой	HemaCarotid Patch	InterVascular SAS	
13	Ембол - екстрактор катетър 2,3,4,5,6F - 80 см, еднобалонен, еднолуменен	брой	Arterial Embolectomy Catheter	Neuromed ex GmbH	
14	Комплект за венострипинг включващ : метално жило с FEP- покритие, с дължина 100 см; 4 глави от поликарбонат с диаметър 6мм, 9мм,12 мм и 15 мм и дръжка от поликарбонат.	брой	Medistrip Disposable Vein Stripper	Neuromed ex GmbH	

2. Прилагаме оторизационни писма на името на участника от:

а/ производителя на съответните медицински изделия и консумативи или
б/ от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка със съответните изделия на производителя – заверено от участника копие.

3. Прилагаме сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия и консумативи съгласно изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "CE" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ – заверено от участника копие (посочва се за коя номенклатурна единица се отнасят).


4. Прилагаме проспекти на български език с всички технически показатели и параметри на предлаганите медицински изделия и консумативи и указания за употреба.

5. Предлагаме срок на доставка на медицинско изделие - до 72 (седемдесет и два) часа след подадена от възложителя писмена заявка за доставка, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на доставка, различен от обявения (предлаганият срок не следва да е по-дълъг от 72 часа).

6. Към момента на доставянето на медицинско изделие ще е със срок на годност не по-кратък от 70 % от срока на годност, даден от неговия производител, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на годност, различен от обявения.

7. Представляваното от мен дружество/обединение – се задължава да изпълни предмета на обществената поръчка в съответствие с всички действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо:

1. за качественото изпълнение на поръчката, както и

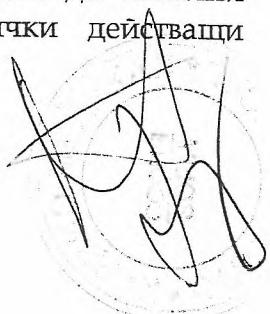

2

2. за изпълнение на всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

8. Декларирам,¹ че действителният собственик по смисъла на §2, ал.1 от ДР на ЗМИП на представляваното от мен дружество е следното физическо лице:

1. Александър Константинов Маджаров,

запълнени на основание чл.3ба, ал. 3 от ЗОП.

София,

9. Връзка с чл.66 от ЗМИП ²декларирам, че

- основната дейност на дружеството е търговия на едро с медицински изделия

паричните средства за изпълнение на обществената поръчка съгласно ценовото ни предложение и за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка имат следния произход: търговия на едро с медицински изделия кредитна линия за гаранции в Уникредит Булбанк АД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.


10. Декларирам, че сме съгласни да получаваме протоколите, решениета, писмата и други документи от Възложителя на електронната поща, която сме посочили в еЕДОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

30.08.2019 г.

дата

Име и фамилия Александър Маджаров
Подпись на лицето (и печат)

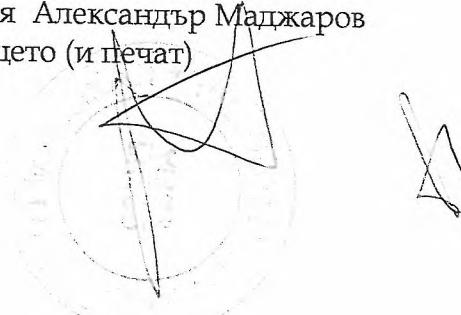

¹ Когато участникът е обединение/консорциум, всички съдружници в обединението/консорциумът посочват кои са действителните собственици на техните дружества в отделни декларации към Техническото предложение.

² Когато участникът е обединение, тази декларация се подписва от съдружника в обединението, който ще внесе гаранцията за изпълнение на договора, а когато гаранцията за участие се внася от трето лице - декларацията се подписва от него.



КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД

Бул. "Цар Борис III" № 23

София 1612

тел./факс: 02 953 3616

e-mail: cardiomedical@abv.bg

Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП


От "Кардио Медикал" ЕООД (наименование на участника) с ЕИК 201980901 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установлен), представявано от Александър Константинов Малжаров (имената на законния или упълномочен

заличени на основание чл. 3 ба., ал. 3 от ЗОП.

доставка на медицински изделия за ортопедия и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

1. Участваме за обособена позиция № 54 Ангиографски консуматив / Раздел Съдова хирургия

Но мер на ном ен- кла тур а	Изисквания на възложителя		Предложения на участника		
	Описание	Опаковка/ Мерна единица	Търговско наименование	Производит ел	Други особеност и по оценка на изпълните ля
1	2	3	4	5	6
1	Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии. Материал на стента : кобалт - хром L 605. Carbofilm технология / чист въглерод / на покритие на стента под формата на тънък филм с дебелина ≤ 0.3μm. Структурен дизайн - тип затворена клетка. Дебелина на стратовете - 175 μm. Огледално	брой	Isthmus Logic Carbostent	CID S.p.A.	



	електрополиране на повърхността на стента.2 рентгенопозитивни маркера от платина за прецизно позициониране.Съвместим със 6F водещ катетър и 0.035" водач. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, сгънат на шест,от полиамид, OTW тип. Размери на стента: Диаметър от 6 до 10 mm и дължина от 19 до 59 mm.			
2	Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на инфрапоплитеални артерии.Материал: кобалт - хром L 605.Carbofilm технология на покритие на стента от тънък филм с дебелина ≤ 0.3 μm. Структурен дизайн - тип затворена клетка, , дебелина на стратовете 70 μm / за 2.25 - 2.75 mm / или 80μm / за 3.0 - 4.5 mm /.Синусоидални интерконекторни връзки. Огледално електрополиране на повърхността на стента.2 рентгенопозитивни платинени маркера за прецизно позициониране. Носещ балон - катетър: от пебакс / за 2.25 - 2.75 mm / или полиамид / 3.0 - 4.5 mm /, Rapid Exchange тип, с ComfortCoat хидрофилно покритие.Съвместим с 4F водещ катетър и .014" водач.Размери - диаметър - от 2.25mm до 4.5mm; дължина - от7mm до 31mm	брой	CRE8 ВТК	CID S.p.A.
3	Саморазгъващ се ендolumинален стент за периферна ангиопластика .Материал : нитинол.8 танталови рентгенпозитивни маркери за прецизно позициониране / по 4 в двета края /. Допълнителен маркер върху носещата система, на 6 mm от дисталния край,позволяващ прецизно проследяване на имплантирането на стента.Контролиран механизъм с 4 опции за освобождаване на стента - спусъков, пъзгачен, комбиниран и конвенционален.Структурен дизайн - тип отворена клетка.Изрязани участъци от 2 mm в краишата за предотвратяване на миграция на стента.Съвместим с 8F водещ катетър,6F интродюсер и .035" водач. Размери - диаметър- 4 до 14 mm, дължина - от 20 до 120 mm.	брой	Easy FLYPE / HIFLYPE Carbostent	CID S.p.A.

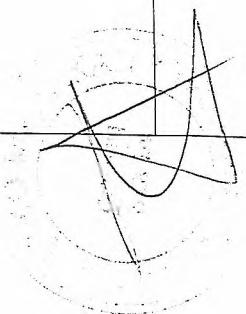

2. Прилагаме оторизационни писма на името на участника от:

- а/ производителя на съответните медицински изделия и консумативи или
- б/ от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка със съответните изделия на производителя – заверено от участника копие.

3. Прилагаме сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия и консумативи съгласно изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "CE" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ – заверено от участника копие (посочва се за коя номенклатурна единица се отнасят).

4. Прилагаме проспекти на български език с всички технически показатели и параметри на предлаганите медицински изделия и консумативи и указания за употреба.

5. Предлагаме срок на доставка на медицинско изделие - до 72 (седемдесет и два) часа след подадена от възложителя писмена заявка за доставка, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на доставка, различен от обявения (предлаганият срок не следва да е по-дълъг от 72 часа).

6. Към момента на доставянето на медицинско изделие ще е със срок на годност не по-кратък от 70 % от срока на годност, даден от неговия производител, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на годност, различен от обявения.

7. Представляваното от мен дружество/обединение се задължава да изпълни предмета на обществената поръчка в съответствие с всички действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо:

1. за качественото изпълнение на поръчката, както и
2. за изпълнение на всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

8. Декларирам,¹ че действителният собственик по смисъла на §2, ал.1 от ДР на ЗМИП на представляваното от мен дружество е следното физическо лице:

1. Александър Константинов Маджаров,
(име, презиме, фамилия)

запличени на основание чл.3 ба, ал. 3 от ЗОП.

9. Връзка с чл.66 от ЗМИП ²декларирам, че

¹ Когато участникът е обединение/консорциум, всички съдружници в обединението/консорциумът посочват кои са действителните собственици на техните дружества в отделни декларации към Техническото предложение.





- основната дейност на дружеството е търговия на едро с медицински изделия

паричните средства за изпълнение на обществената поръчка съгласно ценовото ни предложение и за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка имат следния произход: търговия на едро с медицински изделия кредитна линия за гаранции в Уникредит Булбанк АД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

10. Декларирам, че сме съгласни да получаваме протоколите, решенията, писмата и други документи от Възложителя на електронната поща, която сме посочили в еЕДОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

30.08.2019 г.

дата

Име и фамилия

Александър Маджаров

Подпись на лицето (и печат)

² Когато участникът е обединение, тази декларация се подписва от съдружника в обединението, който ще внесе гаранцията за изпълнение на договора, а когато гаранцията за участие се внася от трето лице - декларацията се подписва от него.



КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД

Бул. „Цар Борис III“ № 23
София 1612 тел./факс: 02 953 3616

e-mail: cardiomedical@abv.bg

Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Кардио Медикал“ ЕООД (наименование на участника)
с ЕИК 201980901 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),
представлявано от Александър Комстантинов Маджаров (имената на законния


заличени на основание чл. 3 ба., ал. 3 от ЗОП.

**и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за
период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД,**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предложените от нас цени са следните:

№ на номенклатура	Търговско наименование *	Производител	Опаковка/ Мерна единица	Прогноз-но количество за две години	Единична цена в лева без ДДС за опаковка / брой от колона 5	Стойност в лева без ДДС (колона 5 x колона 6)
1	2*	3	4	5	6	7
1	Avantgarde Chrono Carbostent	CID S.p.A.	брой	50	150.00	7 500.00
2	CRE8	CID S.p.A.	брой	100	375.00	37 500.00
3	Isthmus Logic Carbostent	CID S.p.A.	брой	50	658.33	32 916.50

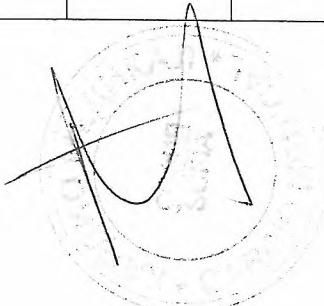

4	Radix2 Carbostent	CID S.p.A.	брой	20	658.33	13 166.60
5	Easy FLYPE / HIFLYPE Carbostent	CID S.p.A.	брой	50	798.33	39 916.50
6	ADVANTA V12 Vascular Covered Stent	Atrium Medical Corp.	брой	30	2 000.00	60 000.00
7	CRE8 BTK	CID S.p.A.	брой	100	666.66	66 666.00
8	E - Luminexx Vascular Stent	Angiomed GmbH /собствен ост на BARD/	брой	30	798.33	23 949.90
9	Ultraverse 035 PTA Balloon Dilatation Catheters	BARD	брой	30	233.33	6 999.90
1	Ultraverse 018 PTA Balloon Dilatation Catheters	BARD	брой	100	333.33	33 333.00
2	Presto Inflation Device	BARD	брой	50	75.00	3 750.00
3	Seeker Crossing Support Catheter	BARD	брой	100	333.33	33 333.00

*Забележка: В колона 2 „Търговско наименование“ следва да се впише точното наименование на лекарствения продукт/ медицинското изделие така, както е оферирало в „Предложение за изпълнение на поръчката“.

1. Предложената от нас обща стойност за изпълнение на поръчката е, както следва:

1.1. без ДДС 359 031.40 лв. (триста петдесет и девет хиляди тридесет и един лева и 0,40 стотинки словом);

1.2. с ДДС 430 837.68 лв. (четиристотин и тридесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и 0,68 стотинки словом).

2. Единичните цени са оферираните с точност до втори знак след десетичната запетая.




3. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, изразяваме съгласие заплашането за извършваните от нас доставки да е в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от възложителя на оригинална данъчна фактура, придруженя с приемо-предавателен протокол.

5. Други предложения

Дата: 30.08.2019 г.

Подпись

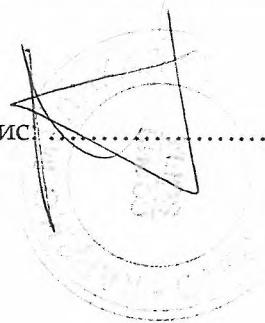

КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД

Бул. „Цар Борис III“ № 23

София 1612 тел./факс: 02 953 3616

e-mail: cardiomedical@abv.bg

Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Кардио Медикал“ ЕООД (наименование на участника)

с ЕИК 201980901 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), представявано от Александър Комстантинов Малжаров (имената на законния


заличени на основание чл. Зба., ал. 3 от ЗОП.

обществена поръчка с предмет **доставка на медицински изделия за ортопедия и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД,**


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предложените от нас цени са следните:

№ на номенклатура	Търговско наименование *	Производител	Опаковка/Мерна единица	Прогнозно количество за две години	Единична цена в лева без ДДС за опаковка / брой от колона 5	Стойност в лева без ДДС (колона 5 x колона 6)
1	2*	3	4	5	6	7
1	InterGard Silver, Antimicrobial Knitted Straight Collagen Coated Vascular Prosthesis	InterVascular SAS	брой	15	900.00	13 500.00
2	InterGard Silver, Antimicrobial Knitted Bifurcated	InterVascular SAS	брой	15	895.83	13 437.45

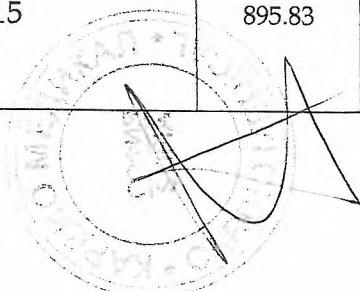

	Collagen Coated Vascular Prostheses					
3	InterGard Synergy, Antimicrobial Knitted Straight Collagen Coated Vascular Prostheses	InterVascular SAS	брой	15	900.00	13 500.00
4	InterGard Synergy, Antimicrobial Knitted Bifurcated Collagen Coated Vascular Prostheses	InterVascular SAS	брой	15	895.83	13 437.45
5	InterGard Knitted Vascular Prostheses Straight	InterVascular SAS	брой	70	550.00	38 500.00
6	InterGard Knitted Vascular Prostheses Bifurcated	InterVascular SAS	брой	12	745.83	8 949.96
7	InterGard Knitted Heparin Ultrathin Straight, Collagen Coated & Heparin Bonded Vascular Prostheses	InterVascular SAS	брой	4	900.00	3 600.00
8	InterGard Knitted Heparin Bifurcated, Collagen Coated & Heparin Bonded Vascular Prostheses	InterVascular SAS	брой	4	895.83	3 583.32

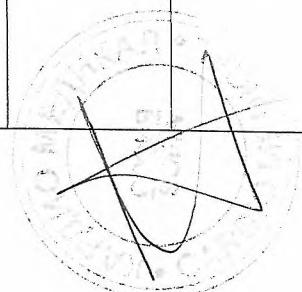

9	ADVANTA PTFE Vascular Grafts	Atrium Medical Corporation	брой	20	766.67	15 333.40
10	ADVANTA PTFE Vascular Grafts	Atrium Medical Corporation	брой	20	766.67	15 333.40
11	AvFlo Vascular Access Grafts	NICAST Ltd.	брой	30	766.67	23 000.10
12	HemaCarotid Patch	InterVascular SAS	брой	30	266.67	8 000.10
13	Arterial Embolectomy Catheter	Neuromed ex GmbH	брой	150	53.33	7 999.50
14	Medistrip Disposable Vein Stripper	Neuromed ex GmbH	брой	100	30.00	3 000.00

*Забележка: В колона 2 „Търговско наименование“ следва да се впише точното наименование на лекарствения продукт/ медицинското изделие така, както е оферирano в „Предложение за изпълнение на поръчката“.

1. Предложената от нас обща стойност за изпълнение на поръчката е, както следва:

1.1. без ДДС 181 174.68 лв. (сто осемдесет и една хиляди сто седемдесет и четири лева и 0,68 стотинки *словом*);

1.2. с ДДС 217 409.62 лв. (двеста и седемнадесет хиляди четиристотин и девет лева и 0,62 стотинки *словом*).

2. Единичните цени са оферираните с точност до втори знак след десетичната запетая.


3. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, изразяваме съгласие заплащането за извършваните от нас доставки да е в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от възложителя на оригинална данъчна фактура, придружена с приемо-предавателен протокол.

5. Други предложения

.....

Дата: 30.08.2019 г.

Подпись:



КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД

Бул. „Цар Борис III“ № 23

София 1612 тел./факс: 02 953 3616

e-mail: cardiomedical@abv.bg

Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Кардио Медикал“ ЕООД (*наименование на участника*)
с ЕИК 201980901 (*ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установлен*),
представлявано от Александър Комстантинов Маджаров (*имената на законния*


заличени на основание чл. Зба, ал. 3 от ЗОП.

**и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за
период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД,**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предложените от нас цени са следните:

№ на номенклатура	Търговско наименование *	Производител	Опаковка/ Мерна единица	Прогноз-но количество за две години	Единична цена в лева без ДДС за опаковка / брой от колона 5	Стойност в лева без ДДС (колона 5 x колона 6)
1	2*	3	4	5	6	7
1	Isthmus Logic Carbostent	CID S.p.A.	брой	40	658.33	26 333.20
2	CRE8 BTK	CID S.p.A.	брой	10	666.67	6 666.70
3	Easy FLYPE / HIFLYPE Carbostent	CID S.p.A.	брой	30	798.33	23 949.90

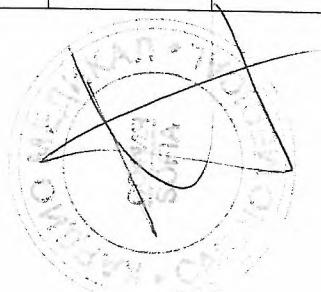

*Забележка: В колона 2 „Търговско наименование“ следва да се впише точното наименование на лекарствения продукт/ медицинското изделие така, както е оферирano в „Предложение за изпълнение на поръчката“.

1. Предложената от нас обща стойност за изпълнение на поръчката е, както следва:

1.1. без ДДС 56 949.80 лв. (петдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и 0.80 стотинки *словом*);

1.2. с ДДС 68 339.76 лв. (шестдесет и осем хиляди триста тридесет и девет лева и 0.76 стотинки *словом*).

2. Единичните цени са оферираните с точност до втори знак след десетичната запетая.

3. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, изразяваме съгласие заплащането за извършваните от нас доставки да е в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от възложителя на оригинална данъчна фактура, придружена с приемо-предавателен протокол.

5. Други предложения

.....
Дата: 30.08.2019 г.

Подпись:

