

| № | Описание  | Мярка | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Търговско Наименование | Каталожен номер | Производител | Ед. мнн | Обща стойност |
|---|---|-------|---|------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------|
| 1 | Медицимент излъчващ коронарен стент от кобалт-хром без полимер в покритието, с биоабсорбируема матрица от Сирилимус – 1.2 µg/mm <sup>2</sup> и Пробукол (50:50); с аблуминално roll-on-free покритие, подпомагащо бързата ендотелиализация; със страт – 55 µm (при диаметри 2.0-3.0 mm) и 65 µm (при диаметри 3.5-4.0 mm); с висока гъвкавост и висока проходимост; с отворен клетъчен диаметър; дължина 145 cm; с профил на входа на лезията 0.016" (0.41 mm); с профил на преминаване (crossing profile) – 0.031" – 0.038" (0.79 mm – 0.96 mm); с проксимален шифт 1.9F; с дистален шифт 2.5F; съвместим с водещ катетър 5F/"kissing balloon"; 6F; съвместим с водач 0.014" (0.36 mm); номинално налягане 10atm, RBP 18atm; с размери: диаметри 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm с дължина 9mm, 12mm, 16mm, 19mm, 24mm, 28mm, 32mm, 38mm | бр.   | 288   |                        |                 |              |         |               |
| 2 | Коронарен стент от кобалт-хромиева сплав L605 с по-малко от 30 % съдържание на никел; дебелина на страта 60 µm; дизайн: девет корони с три свързващи мостчета, отворен клетъчен диаметър (0.9 mm -1.3 mm); профил на входа на лезията 0.016"; проксимален шифт 1.9F, проксимално на балона по-малко от 0.5 mm от всяка страна; профил на преминаване: 2.75 mm – 0.033"; 3.0 mm – 0.034"; 3.5 mm – 0.035"; 4.0 mm – 0.035"; размери : диаметри 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm с дължина 8 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 24 mm, 27 mm и 32 mm   | бр.   | 50  |                        |                 |              |         |               |
| 3 | PTCA балон катетър, материал SOMAX; четиристранно съгнат; нисък профил на върха - 0.016"; дължина 145 cm, проксимален шифт 1.9 F, дистален шифт 2,5 F, HPTS – система, улесняваща добрата навигация; съвместим с 5F водещ катетър; съвместим с водач 0.014"; специално покритие улесняващо приплавването; hard-soft връх; наличен в диаметри 1.25 и 1.5, подходящи за лечение на хронични тотални оклузии; размери: диаметри 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm с дължина 10mm, 15mm, 25mm, 30mm и диаметри 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm с дължина 20mm  | бр.   | 200   |                        |                 |              |         |               |
| 4 | Non-compliant балон катетър, материал Nuon; четиристранно съгнат; нисък профил на върха - 0.016" (0.41mm); дължина 140 cm, проксимален шифт 1.9 F, дистален шифт 2,7 F, HPTS – система, улесняваща добрата навигация; съвместим с 5F водещ катетър; съвместим с водач 0.014"; брахиален и феморален маркер 90 смб 100см; подходящ за подготовка на лезията и постдилатация под високо налягане; размери: диаметри 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm с дължини 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 30mm  | бр.   | 400   |                        |                 |              |         |               |
| 5 | Паклитаксел излъчващ PTCA балон катетър с матрично покритие от Rapiflexel и Lorpromide с проксимален шифт – 1.9F, Дистален шифт - 2.5F, Дължина – 145 cm, брахиален и феморален маркер – 100 cm и 110 cm , съвместим с водещ катетър 5F; съвместим с водач 0.014"; профил на върха – 0.016"; профил на преминаване: 0.031" – 0.033", номинално налягане: 6 atm., максимално налягане: 14 atm., размери: диаметри 2.0mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm с дължина 10 mm, 15mm, 20 / 17mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm   | бр.   | 100   |                        |                 |              |         |               |
| 6 | Балон с 3 скоринг елемента от найлон за ефективна подготовка на лезията, проксимален шифт 2,1 F, дистален шифт 2,7 F, съвместимост с водач 0, 014", номинално налягане 6 atm., дължина 13 mm, диаметри 2 mm, 2,25mm, 2,5mm, 2,75 mm, 3mm, 3,5 mm, 4 mm  | бр.   | 40  |                        |                 |              |         |               |
| 7 | Периферен самораазгващ се ендоваскуларен стент за ангиопластика на милиачни артерии и SFA от Nitinol. С дизайн "отворена клетка"; с двойно полиран страт; с лазерно споени танталови маркери за прецизно позициониране; с рентгенопозитивни платинени маркери; Система 5F, съвместима с водач 0.018" и система 6F, съвместима с водач 0.035"; диаметър на стента 5-10mm; дължина на стента 20-200mm; дължина на шифта 80cm и 120/130cm; наличен и с размер на шифта 180cm за трансрадиален/ Трансбрахиален достъп; специална LRF (Low Radial Force) версия  | бр.   | 100   |                        |                 |              |         |               |

|    |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 8  | Медицимент излъчващ периферен балон, с Пакулитаксел 3гг/мм <sup>2</sup> в матрица с Ресвератрол; с катетър OTW; съвместим с периферен водач 0.035"; с дължина на катетъра 75 см/130см; semi-compliant; от материал HDPE, Pexag/Peвак; с профил на входа на лезията 4.0мм: 0.04"/1.04мм, 5.0-7.0мм: 0.04"/1.18мм, 8.0мм: 0.04"/1.30мм; с кросинг профил 4.0мм: 0.0650"/1.65мм, 5.0-7.0мм: 0.0709"/1.80мм, 8.0мм: 0.0715"/1.82мм; с размери: 1. На shaft 75 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм, диаметри 7.0-8.0мм с дължини 40мм и 60мм; 2. На shaft 130 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм   | бр. | 50  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Медицимент излъчващ периферен балон, с Пакулитаксел 3гг/мм <sup>2</sup> в матрица с Ресвератрол; кс катетър OTW, да е съвместим с периферен водач 0.014"; да е с дължина на катетъра 130см; да е semi-compliant; от материал HDPE, Pexag/Peвак; с профил на входа на лезията 0.0181"/0.46мм; с кросинг профил 1.5мм: 0.0374", 2.0мм: 0.0413", 2.5мм: 0.0413", 3.0мм: 0.0453"; с размери: диаметър 1.5мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, диаметри 2.0-3.0мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, 150мм   | бр. | 50  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Медицимент излъчващ периферен балон, с Пакулитаксел 3гг/мм <sup>2</sup> в матрица с Ресвератрол; катетър OTW, да е съвместим с периферен водач 0.018"; с дължина на катетъра 75см и 130см; semi-compliant; от материал HDPE, Pexag/Peвак; 3 странично сгънат, съвместим с шийт от 2мм до 4мм с 4Г и от 5мм до 6мм с 5Г мм; с размери: за 75мм, диаметри 3.5мм, 4мм, 5мм и 6мм с дължини между 40мм и 120мм, за 130см, диаметри 2мм, 2.5мм, 3мм, 3.5мм, 4мм, 5мм, 6мм с дължини между 40мм и 120мм  |     | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Водач за PTCA 195 ст 0.014", J и прав връх, хидрофилно покритие, 3 см рентгенпозитивна намотка, различни степени на гъвкавост на върха, СТО равновидности (3,6,9,12 гр.)   | бр. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Коронарен водещ катетър с атравматичен дистанлен мек връх, хидрофилно покритие на shaft, отлична издръжливост при огъване, J1, движение с торкер, голям вътрешен лумен – 0.071" при 6F, размери: 5F в конфигурации: AL1, HS, JL3.5, JL4, JR3.5, JR4, MPA, RAD, TIG2, XB3.5, XB4, EBU3.5, EBU3.75, EBU4; 6F в конфигурации: AL1, AL1.5H, AL1.5, AL1.5 SH, AL2, AL2 SH, AR1, AR1 SH, AR2, AR2 SH, HS, IM, JL3, JL3.5 SH, JL4 SH, JL5, JL5 SH, JR3.5 SH, JR4 SH, JR4 SH, JR4.5 SH, JR5, MPA, MPA SH, RCB, XB3.5, XB3.5 SH, XB4, XB4 SH, XB4.5, EBU3, EBU3 SH, EBU3.5 SH, EBU3.5 SH, EBU4, EBU4 SH, 7F в конфигурации: AL1 SH, AL2 SH, AL3 SH, AL3 SH, AR1 SH, AR2 SH, HS SH, JL3 SH, JL4 SH, JL4.5 SH, JL5 SH, JR3.5 SH, JR4 SH, JR4.5 SH, JR5 SH, MPA SH, EBU3 SH, EBU3.5 SH, EBU3.75 SH, EBU4 SH, EBU4.5 SH | бр. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Инфляционна манометър спринцовка за PTCA; обем 25 мл, до 30 атмосфери; с 30 см линия за високо налягане с трипътно спирателно крайче; лесно заключващ се механизъм с крилица   | бр. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пункционна игла 18 G 7 см  | бр. | 100 |  |  |  |  |  |  |

|    |  |     |       |  |  |  |  |  |       |
|----|--|-----|-------|--|--|--|--|--|-------|
| 15 | Дренажен сет: Сет за перикарддицентеза с включена пункционна игла 18G, 120 mm. Съдържа: Пункционна игла 18G, 120 mm, Дренажен катетър с мандрен, Дилатор 16 с разцепващи се интродусерни маншети, Канюла размер 0.9x70mm, Скапел за еднократна употреба, Торбичка за секрет с обеми 1500 ml, Помпено устройство, Спринцовка с луер-лок 50ml, Спринцовка с луер-лок 10ml, Диагностичен водач J3, Покривна кърпа   | бр. | 20    |  |  |  |  |  |       |
| 16 | Двупълтно кранце /Многопълтник/ Двупълтно кранце за високо налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна, ON и OFF версия   | бр. | 500   |  |  |  |  |  |       |
| 17 | Трипълтно кранце /Многопълтник/ Трипълтно кранце за високо налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна, ON и OFF версия   | бр. | 500   |  |  |  |  |  |       |
| 18 | Диагностичен водач с PTFE покритие от неръждаема никел-хромиева сплав, с диспенсер и луер лок фитинг, J-чр, 0.035", 175cm, гъвкав и гладко заоблен връх на водача.   | бр. | 600   |  |  |  |  |  |       |
| 19 | Диагностичен водач с PTFE покритие от неръждаема никел-хромиева сплав, с диспенсер и луер лок фитинг, J-чр, 0.035", 260cm, гъвкав и гладко заоблен връх на водача.   | бр. | 400   |  |  |  |  |  |       |
| 20 | У- конектор - единичен Y-конектор, единичен, лумен 9.5F, с ротиращ адаптор   | бр. | 100   |  |  |  |  |  |       |
| 21 | Удължител 50 cm + трипълтно кранце   | бр. | 2 000 |  |  |  |  |  |       |
| 22 | Удължители за подаване на контрастна материя под налягане с наконечник тип Luer-Lock, устойчиви на високо налягане(1425PSI) с размери: дължина 60, 90, 120, 150 cm   | бр. | 200   |  |  |  |  |  |       |
| 23 | Система за венозен достъп Пот-а-Кат от полисулфон с титаниева камера, стандартна камера с размери 35x22mm, височина 13.2mm, дължина на мембраната 12mm, малка камера 30x22mm с височина 10.6mm с дължина на мембраната 9.5mm, силиконов или PUR катетър 6.5F и 8.5F, с включен сет по Селдингер.   | бр. | 200   |  |  |  |  |  |       |
| 24 | Система за венозен достъп Пот-а-Кат от полисулфон без титаниева камера, стандартна камера с размери 38x26mm, височина 11.5mm, дължина на мембраната 12mm, малка камера 32x22mm с височина 11mm с дължина на мембраната 8mm, силиконов или PUR катетър 4.5F ; 5F и 6F, с включен сет по Селдингер.  | бр. | 200   |  |  |  |  |  |       |
| 25 | Периферни венозни катетри, без допълнителен порт. Катетър от полиуретан, с аграматичен профил и 4 вградени рентгенопозитивни линии. Тънкостенна игла за бързо изтичане на кръв, с вграден хидрофобен филтър и триплостностно заточване за лесна перфорация на кожата. Прозрачна камера за контрол на изтичането на кръв. Със и без крилица с дупки за укръпване с конект. Автоматичен (пасивен), изцяло метален предпазен механизъм, покриващ върха на иглата след изваждане от катетъра. Цветен код за размера. Размери от 6.14 до G20.                       | бр. | 4000  |  |  |  |  |  |       |
| 26 | Временен Вена Кава филтър, предварително зареден във ввеждаща спринцовка, за кюларен и за феморален достъп, материал финокс – неферомагнитна сплав изцяло видима под рентгенови лъчи и идеално съвместима с изобразяване с магнитен резонанс, с 8 стабилизирани крачета с кукички на четири нива, ефективен коничен дизайн, дължина на конуса 40 mm, височина 53 mm, за използване при Вена Кава с диаметър ≥14 mm и ≤28 mm, в комплект с F7 интродусер с хемостатична клапа, J-водач с PTFE покритие с дължина 1500mm и диаметър 0.035", късо и дълго бутало. | бр. | 25    |  |  |  |  |  |       |
| 27 | Сет за премахване на временен Вена Кава филтър през дясна Вена Югупарис Интерна, за използване при филтър от финокс с 8 стабилизирани крачета с кукички на четири нива, коничен дизайн с дължина на конуса 40 mm, височина 53 mm, за използване при Вена Кава с диаметър ≥14 mm и ≤28 mm   | бр. | 25    |  |  |  |  |  |       |
| 28 | Виполгаран електрод за временна трансвенозна кардиостимулация – с балон<br>- материал на електродите – неръждаема стомана<br>- дължина на електрода 3 mm,<br>- разстояние на електродите – 10 mm,<br>- дължина 110 cm,<br>- материал на катетъра – антитромбогенен Полиуретан<br>- маркер на всеки 100 mm от върха на катетъра<br>- не съдържа PVC<br>- с включена еднократна спринцовка със стюпер за прецизно раздуване на балона<br>- размер – SF   | бр. | 50    |  |  |  |  |  |       |
| 29 | Тапа за венозен катетър/система. Двоен накрайник (мъжко/женско), подходяща за венозни катетри и интравенозни системи. В самостоятелна стерилна опаковка.   | бр. | 3000  |  |  |  |  |  | ОБЩО: |






Обособена позиция 42

| № | Описание       | Мярка | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Търговско Наименование | Каталожен номер | Производител | Ед.цena      | Обща стойност |
|---|----------------|-------|---|------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Затварящ конус | бр.   | 2 000   |                        |                 |              |              |               |
|   |                |       |   |                        |                 |              | <b>ОБЩО:</b> |               |



Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката  
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя  
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП



От „Булмед 2000“ ЕООД (наименование на участника) с 121268853 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


**заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.**

ил  
дена  
ЗОП  
на  
две

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложи в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

1.Участваме за обособена позиция №34

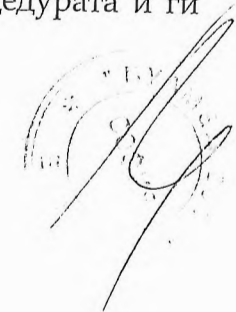




София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Толстобег“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. Е-пoст: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

| Номер на номен-клатура | Изисквания на възложителя  | Предложения на участника   |                         |   |                            |
|------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---|----------------------------|
|                        |  | Търговско наименование     | Производител            | Други особености по преценка на изпълнителя |                            |
| 1                      | 2  | 3                          | 4                       | 5   | 6                          |
| 1                      | Описание<br><br>Медикамент излъчващ коронарен стент от кобалт-хром без полимер в покритието, с биорезорбируема матрица от Сиролимус - 1.2 µg/mm <sup>2</sup> и Пробукол (50:50); с аблуминално polymer-free покритие, подпомагащо бързата ендотелиализация; със страт - 55 µm (при диаметри 2.0-3.0 мм) и 65 µm (при диаметри 3.5-4.0 мм); с висока гъвкавост и висока проходимост; с отворен клетъчен диаметър; дължина 145 см; с профил на входа на лезията 0.016" (0.41 mm); с профил на преминаване (crossing profile) - 0.031" - 0.038" (0.79 mm - 0.96 mm); с проксимален shaft 1.9F; с дистален shaft 2.5F; съвместим с водещ катетър 5F/ "kissing balloon": 6F; съвместим с водач 0.014" (0.36 mm); номинално налягане 10atm, RBP 18atm; с размери: диаметри 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 9мм, 12мм, 16мм, 19мм, 24мм, 28мм, 32мм, 38мм | Опак овка / Мер на единица | Coroflex<br>ISAR<br>NEO | B. Braun<br>Melsungen AG                    | Кат. № 5028910-<br>5028965 |


София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тодор Бабев“ № 21. Тел: 02/9154 211 ; Факс: 02/951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

|   |   |     |                      |                          |                            |
|---|---|-----|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2 | <p>Коронарен стент от кобалт-хромиева сплав L605 с по-малко от 30 % съдържание на никел; дебелина на страта 60 µm; дизайн: девет корони с три свързващи мостчета, отворен клегъчен диаметър (0,9 мм -1,3 мм); профил на входа на лезията 0.016"; проксимален shaft 1.9F, проминиране на балона по-малко от 0.5 мм от всяка страна; профил на преминаване: 2.75 мм – 0.033", 3.0 мм – 0.034", 3.5 мм – 0.035", 4.0 мм – 0.035"; размери : диаметри 2.75 мм, 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм с дължина 8 мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм и 32 мм</p>   | бр. | Coroflex<br>Blue NEO | B. Braun<br>Melsungen AG | Кат. № 5029012-<br>5029085 |
| 3 | <p>PTCA балон катетър, материал SOMAX; четиристранно сгънат; нисък профил на върха - 0.016"; дължина 145 см, проксимален shaft 1,9 F, дистален shaft 2,5 F, NPFS – система, улесняваща добрата навигация; съвместим с 5F водещ катетър; съвместим с водач 0.014"; специално покритие улесняващо припльзването; hard-soft връх; наличен и в диаметри 1.25 и 1.5, подходящи за лечение на хронични тотални оклузии; размери: диаметри 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 10мм, 15мм, 25мм, 30мм и диаметри 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 20мм</p> | бр. | SeQuent<br>NEO       | B. Braun<br>Melsungen AG | Кат. № 5021711-<br>5021759 |
| 4 | <p>Non-compliant балон катетър, материал Nylon; четиристранно сгънат; нисък профил на върха - 0.016"(0,41mm); дължина 140 см, проксимален</p>   | бр. | SeQuent<br>NEO NC    | B. Braun<br>Melsungen AG | Кат. № 5023900-<br>5023968 |

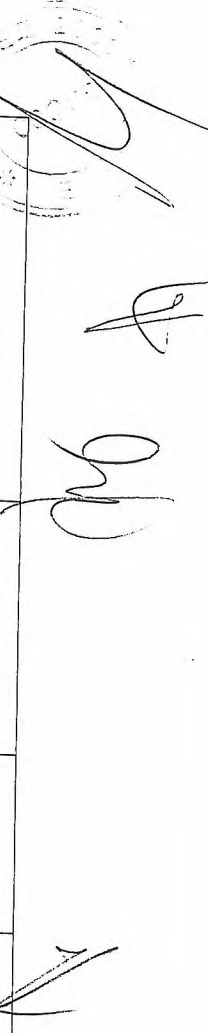

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Толбухин“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <p>шафт 1,9 F, дистален шафт 2,7 F, НРТС – система, улесняваща добрата навигация; съвместим с 5F водещ катетър; съвместим с водач 0.014", брахиален и феморален маркер 90 см§ 100см; подходящ за подготовка на лезията и постдилатация под високо налягане; размери: диаметри 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм, 4.5мм с дължини 8мм, 10мм, 12мм, 15мм, 20мм, 30мм</p>   |   |  |
| 5 | <p>Паклитаксел излъчващ РТСА балон катетър с матрично покритие от Rapitaxel и Lorpromide с проксимален шафт – 1,9F, дистален шафт - 2.5F, дължина – 145 см, брахиален и феморален маркер – 100 см и 110 см , съвместим с водещ катетър 5F, съвместим с водач 0.014", профил на върха – 0,016", профил на преминаване: 0,031"- 0,033", номинално налягане: 6 атм., максимално налягане: 14 атм., размери: диаметри 2.0мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 10 мм, 15мм, 20 / 17мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм</p> | <p>SeQuent<br/>Please NEO</p> <p>B. Braun<br/>Melsungen AG</p> <p>кат. № 5023200-<br/>5023267</p> |  |
| 6 | <p>Балон с 3 скоринг елемента от найлон за ефективна подготовка на лезията, проксимален шафт 2,1 F, дистален шафт 2,7 F, съвместимост с водач 0, 014", номинално налягане 6 атм., дължина 13 мм, диаметри 2 мм, 2,25мм, 2,5мм, 2,75 мм, 3мм, 3,5 мм, 4 мм</p>  | <p>NSE Alpha</p> <p>Goodman Co LTD</p>  | <p>кат. № NSA20013<br/>NSA22513<br/>NSA25013<br/>NSA27513<br/>NSA30013<br/>NSA35013<br/>NSA40013</p> |

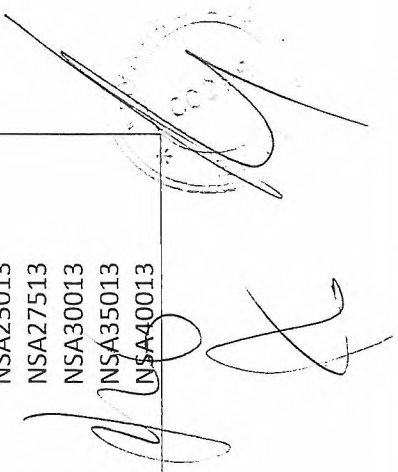

София 1606, р-т „Крайно село“, бул. „Толтебег“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

|   |   |     |                              |  |
|---|---|-----|------------------------------|--|
| 7 | <p>Периферен саморазгъващ се ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии и SFA от Нитинол. С дизайн "отворена клетка"; с двойно полиран страг; с лазерно споени танталови маркери за прецизно позициониране; с рентгенопозитивни платинени маркери; Система 5F, съвместима с водач 0.018" и система 6F, съвместима с водач 0.035"; диаметър на стента 5-10мм; дължина на стента 20-200мм; дължина на шфта 80см и 120/130см; наличен и с размер на шфта 180см за трансрадиален/ трансбрахиален достъп; специална LRF (Low Radial Force) версия</p>  | бр. | Vascuflex                    | B. Braun<br>Melsungen AG<br><br>Kat. № 5505000-5506315   |
| 8 | <p>Медикамент излъчващ периферен балон, с Пакликасел 3μg/мм<sup>2</sup> в матрица с Ресвератрол; с катетър OTW; съвместим с периферен водач 0.035"; с дължина на катетъра 75 см/130см; semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Rebah; д с профил на входа на лезията 4.0мм: 0.04"/1.04мм, 5.0-7.0мм: 0.04"/1.18мм, 8.0мм: 0.04/1.30мм; с кросинг профил 4.0мм: 0.0650"/1.65мм, 5.0-7.0мм: 0.0709/1.80мм, 8.0мм: 0.0715"/1.82мм; с размери: 1. На шaft 75 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм, диаметри 7.0-8.0мм с дължини 40мм и 60мм; 2. На шaft 130 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм</p> | бр. | SeQuent<br>Please OTW<br>035 | B. Braun<br>Melsungen AG<br><br>Kat. № 35040040-35360150 |

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature and date)*






София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Толубен“ № 21. Тел: 02/9154 211 ; Факс:02/951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

|    |   |     |                        |                               |                                |
|----|---|-----|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 9  | Медикамент излъчващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/мм <sup>2</sup> в матрица с Ресвератрол; кс алетър OTW, да е съвместим с периферен водач 0.014", да е с дължина на катетъра 130см; да е semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Rebah; с профил на входа на лезията 0.0181"/0.46мм; с кросинг профил 1.5мм: 0.0374", 2.0мм: 0.0413", 2.5мм: 0.0413", 3.0мм: 0.0453"; с размери: диаметър 1.5мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, диаметри 2.0-3.0мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, 150мм       | бр. | SeQuent Please OTW 014 | B. Braun Melsungen AG         | Kat. № 14215040-14230150       |
| 10 | Медикамент излъчващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/мм <sup>2</sup> в матрица с Ресвератрол; катетър OTW, да е съвместим с периферен водач 0.018"; с дължина на катетъра 75см и 130см; semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Rebah; 3-странно сгънат, съвместим с шийт от 2мм до 4мм с 4F и от 5мм до 6мм с 5F мм; с размери: за 75мм, диаметри 3,5мм, 4мм, 5мм и 6мм с дължини между 40мм и 120мм, за 130см, диаметри 2мм, 2,5мм, 3мм, 3,5мм, 4мм, 5мм, 6мм с дължини между 40мм и 120мм | бр. | SeQuent Please OTW 018 | B. Braun Melsungen AG         | Kat. № 18135040-18260120       |
| 11 | Водач за PTCA 195 cm 0.014", J и прав връх, хидрофилно покритие, 3 см рентгенпозитивна намотка, различни степени на гъвкавост на върха, СТО разновидности (3,6,9,12 гр.)  | бр. | Navitas                | Brivant LTD                   | Kat. № 100-000-000-903-000-010 |
| 12 | Коронарен водещ катетър с аграматичен дистален мек връх, хидрофилно покритие на   | бр. | Sergia                 | PendraCare International B.V. | Kat. № 25400205-27409225       |

Handwritten signature

София 1606, р-н „Кравето село“, бул. „Толбухин“ № 21. Тел: 02/9154 211 ; Факс: 02/951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

|    |   |            |   |
|----|---|------------|---|
|    | <p>шафта, отлична издръжливост при огъване, 1:1 движение с торкер, голям вътрешен лумен – 0.071” при 6F, размери: 5F в конфигурации: AL1, HS, JL3.5, JL4, JR3.5, JR4, MPA, RAD, TIG2, XB3.5, XB4, EBU3.5, EBU3.75, EBU4; 6F в конфигурации: AL1, AL1 SH, AL1.5, AL1.5 SH, AL2, AL2 SH, AR1, AR1 SH, AR2, AR2 SH, HS, IM, IM SH, JL3, JL3 SH, JL3.5, JL3.5 SH, JL4, JL4 SH, JL5, JL5 SH, JR3.5, JR3.5 SH, JR4, JR4 SH, JR4.5 SH, JR5, MPA, MPA SH, RAD, RCB, XB3, XB3.5, XB3.5 SH, XB4, XB4 SH, XB4.5, EBU3, EBU3 SH, EBU3.5, EBU3.5 SH, EBU3.75 SH, EBU4, EBU4 SH, 7F в конфигурации: AL1 SH, AL2 SH, AL3 SH, AR1 SH, AR2 SH, HS SH, JL3 SH, JL3.5 SH, JL4 SH, JL4.5 SH, JL5 SH, JR3.5 SH, JR4 SH, JR4.5 SH, JR5 SH, MPA SH, EBU3 SH, EBU3.5 SH, EBU3.75 SH, EBU4 SH, EBU4.5 SH</p> |            |   |
| 13 | <p>Инфлационна манометър спринцовка за ГТСА; обем 25 мл; до 30 атмосфер; с 30 см линия за високо налягане с трипътно спирателно кранче; лесно заключващ се механизъм с крилица</p>  | <p>бр.</p> | <p>Inflation Device<br/>B. Braun Melsungen AG<br/>Кат. № 5028901</p>                  |
| 14 | <p>Пункционна игла 18 G 7 см</p>  | <p>бр.</p> | <p>Intradyn Arterial Puncture Needle<br/>B. Braun Melsungen AG<br/>Кат. № 5208505</p> |
| 15 | <p>Дренажен сет: Сег за перикардиоцентеза с включена пункционна игла 18G, 120 mm. Съдържа: Пункционна игла 18G, 120 mm, Дренажен катетър с мандрен, Дилататор F6 с разцепващи се</p>  | <p>бр.</p> | <p>Angiodyn Drainage set<br/>B. Braun Melsungen AG<br/>Кат. № 5213300<br/>5213303</p> |

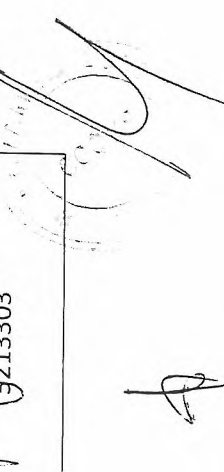



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тодор Бабанов“ № 21. Тел: 02/9154 211 ; Факс: 02/951 6268. Е-mail: [pirrogov@pirrogov.bg](mailto:pirrogov@pirrogov.bg)

|    |  |                          |                       |                |  |
|----|--|--------------------------|-----------------------|----------------|--|
|    | интродюсерни маншети, Канюла размер 0.9x70мм, Скапел за еднократна употреба, Торбичка за секрети с обем 1500 мл, Помпено устройство, Спринцовка с луер-лок 50мл, Спринцовка с луер-лок 10мл, Диагностичен водач J3, Покривна кърпа |                          |                       |                |  |
| 16 | Двупътно кранче / Многопътник/ Двупътно кранче за високо налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна, ON и OFF версия   | Manifold Softgrip 2-port | B. Braun Melsungen AG | Kat. № 5010576 |  |
| 17 | Трипътно кранче / Многопътник/ Трипътно кранче за високо налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна, ON и OFF версия   | Manifold Softgrip 3-port | B. Braun Melsungen AG | Kat. № 5010575 |  |
| 18 | Диагностичен водач с RTFE покритие от неръждаема никел-хромиева сплав, с диспенсер и луер лок фитинг, J-tip, 0.035", 175см, гъвкав и гладко заоблен връх на водача.  | Angiodyn Guidewire 175   | B. Braun Melsungen AG | Kat. № 5059755 |  |
| 19 | Диагностичен водач с RTFE покритие от неръждаема никел-хромиева сплав, с диспенсер и луер лок фитинг, J-tip, 0.035", 260см, гъвкав и гладко заоблен връх на водача.  | Angiodyn Guidewire 260   | B. Braun Melsungen AG | Kat. № 5050359 |  |
| 20 | Y- конектор - единичен Y-конектор, единичен, лумен 9.5F, с ротиращ адаптор   | Y-connector              | B. Braun Melsungen AG | Kat. № 5021693 |  |
| 21 | Удължител 50 см + трипътно кранче  | Discofix C-3             | Б.Браун Мелзунген     | Kat. № 16540С  |  |

А

А



София 1606, р-т „Красно село“, бул. „Толстиев“ № 21. Тел: 02/ 91 54 211 ; Факс: 02/ 951 6368. Е-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

|    |   |     |                               |                       |  |
|----|---|-----|-------------------------------|-----------------------|--|
| 22 | Удължителни за подаване на контрастна материя под налягане с наконечник тип Luer-Lock, устойчиви на високо налягане(1425PSI) с размери: дължина 60, 90, 120, 150 cm   | бр. | Angiodyn High Pressure Tubing | B. Braun Melsungen AG | Кат. № 5011507<br>5011515<br>5011523<br>5011531<br>5016002     |
| 23 | Система за венозен достъп Пот-а-Кат от полисулфон с титаниева камера, стандартна камера с размери 35x22мм, височина 13.2мм, дължина на мембраната 12мм, малка камера 30x22мм с височина 10.6мм с дължина на мембраната 9.5мм, силиконов или PUR катетър 6.5F и 8.5F, с включен сет по Селдингер.  | бр. | Celsite PSU                   | B. Braun Medical SAS  | Кат. № 4430433<br>4430425                                      |
| 24 | Система за венозен достъп Пот-а-Кат от полисулфон без титаниева камера, стандартна камера с размери 38x26мм, височина 11.5мм, дължина на мембраната 12мм, малка камера 32x22мм с височина 11мм с дължина на мембраната 8мм, силиконов или PUR катетър 4,5F ; 5F и 6F, с включен сет по Селдингер.   | бр. | Celsite Implantofix           | B. Braun Medical SAS  | Кат. № 4430263<br>4438604<br>4438704<br>4438647<br>4438747     |
| 25 | Периферни венозни катетри, без допълнителен порт. Катетър от полиуретан, с атравматичен профил и 4 вградени рентгенопозитивни линии. Тънкостенна игла за бързо изтичане на кръв, с вграден хидрофобен филтър и триплосткостно заточване за лесна перфорация на кожата. Прозрачна камера за контрол на изтичането на кръв. Със и без крилица с дупки за укрепване с конец. Автоматичен (пасивен), изцяло метален | бр. | Introsan Safety               | Б.Браун Мелзунген     | Кат. № 4253639-01;<br>4253612-01;<br>4253590-01;<br>4253566-01 |


*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



София 1606, р-н „Крайсто се по“, бул. „Голибеци“ № 21. Тел: 02/9154 211 ; Факс: 02/951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

|    |   |     |   |                          |                |
|----|---|-----|---|--------------------------|----------------|
|    | <p>предпазен механизъм, покриващ върха на иглата след изваждане от катетъра. Цвятен код за размера. Размери от G 14 до G20.</p>   |     |   |                          |                |
| 26 | <p>Временен Вена Кава филтър, предварително зареден във въвеждаща спринцовка, за югуларен и за феморален достъп, материал финокс – неферомагнитна сплав изцяло видима под рентгенови лъчи и идеално съвместима с изобразяване с магнитен резонанс, с 8 стабилизиращи крачета с кукички на четири нива, ефективен коничен дизайн, дължина на конуса 40 мм, височина 53 мм, за използване при Вена Кава с диаметър <math>\geq 14</math> mm и <math>\leq 28</math> mm, в комплект с F7 интродусер с хемостатична клапа, J-водач с РТНЕ покритие с дължина 1500мм и диаметър 0.035", късо и дълго бутало.</p> | бр. | Vena Tech<br>Retrievable                        | B. Braun Medical<br>SAS  | Kat. № 4435150 |
| 27 | <p>Сет за премахване на временен Вена Кава филтър през дясна Вена Югуларис Интерна, за използване при филтър от финокс с 8 стабилизиращи крачета с кукички на четири нива, коничен дизайн с дължина на конуса 40 мм, височина 53 мм, за използване при Вена Кава с диаметър <math>\geq 14</math> mm и <math>\leq 28</math> mm</p>   | бр. | Vena Tech<br>Retrievable<br>Retrieval<br>system | B. Braun Medical<br>SAS  | Kat. № 4435170 |
| 28 | <p>Биполярен електрод за временна трансвенозна кардиостимулация – с балон<br/>- материал на електродите – неръждаема стомана<br/>- дължина на електрода 3 мм;</p>   | бр. | Eledyn  | B. Braun<br>Melsungen AG | Kat. № 5101506 |

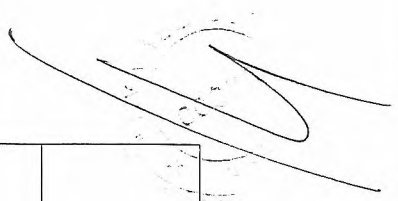


София 1606, р-т „Красно село“, бул. „Толубев“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

|    |  |           |                          |                |
|----|--|-----------|--------------------------|----------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- разстояние на електродите – 10 мм;</li><li>- дължина 110 см;</li><li>- материал на катетъра – анти тромбогенен Полиуретан</li><li>- маркер на всеки 100 мм от върха на катетъра</li><li>- не съдържа PVC</li><li>- с включена еднократна спринцовка със стопер за прецизно раздуване на балона</li><li>- размер – 5F</li></ul> |           |                          |                |
| 29 | Тапа за венозен катетър/система. Двоен крайник (мъжко/женско), подходяща за венозни катетри и интравенозни системи. В самостоятелна стерилна опаковка.   | Combi red | B. Braun<br>Melsungen AG | Кат. № 4495101 |

2. Прилагаме оторизационни писма на името на участника от:

а/ производителя на съответните медицински изделия и консумативи или

б/ от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка със съответните изделия на производителя – заверено от участника копие.

3. Прилагаме сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираниите медицински изделия и консумативи съгласно изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "CE" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ – заверено от участника копие (посочва се за коя номенклатурна единица се отнасят).

4. Прилагаме проспекти на български език с всички технически показатели и параметри на предлаганите медицински изделия и консумативи и указания за употреба.



София 1606, р-н „Крясено село“, бул. „Готлибев“ № 21. Тел: 02/ 91 54 211 ; Факс: 02/ 951 6268. Е-пoст: [pirgovo@pirgovo.bg](mailto:pirgovo@pirgovo.bg)

5. Предлагаме срок на доставка на медицинско изделие - до 72 (седемдесет и два) часа след подадена от възложителя писмена заявка за доставка, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на доставка, различен от обявения (предлаганият срок не следва да е по-дълъг от 72 часа).

6. Към момента на доставянето на медицинско изделие ще е със срок на годност не по-кратък от 75 % от срока на годност, даден от неговия производител, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на годност, различен от обявения.

7. Представяването от мен дружество се задължава да изпълнява да изпълни предмета на обществената поръчка в съответствие с всички действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо:

1. за качествено изпълнение на поръчката, както и
2. за изпълнение на всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

8. Декларирам,<sup>1</sup> че действителният/те собственик/и по смисъла на §2, ал.1 от ДР на ЗМИП на представляваното от мен дружество е /еа/ следното физическо лице/енедните физически лица/:

1. Людмил Борисов Първанов,  
(име, презиме, фамилия)

**ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.36а, ал. 3 ОТ ЗОП.**

(име, презиме, фамилия)  
ЕГН .....  
постоянен адрес .....  
гражданство .....  
документ за самоличност .....

<sup>1</sup> Когато участникът е обединение/консорциум, всички съдружници в обединението/консорциумът посочват кои са действителните собственици на техните дружества в отделни декларации към Техническото предложение.



София 1606, р-н „Крявено село“, бул. „Толлебен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

.....

9. Връзка с чл.66 от ЗМИП<sup>2</sup> декларирам, че

- основната дейност на дружеството е търговия с медицинска техника, резервни части за нея, медицински консумативи и материали, сервизно обслужване и ремонт, диагностика и поддръжка на специализирана медицинска техника, информационна и консултантска дейност, маркетинг, лизинг, реклама, търговско представителство, посредничество и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от закона.

паричните средства за изпълнение на обществената поръчка съгласно ценовото ни предложение и за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка имат следния произход: Търговска дейност

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

10. Декларирам, че сме съгласни да получаваме протоколите, решенията, писмата и други документи от Възложителя на електронната поща, която сме посочили в еЕДОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


11.09.2019г.

дата

Име и фамилия

Людмил Първанов

Подпис на лице (и печат)

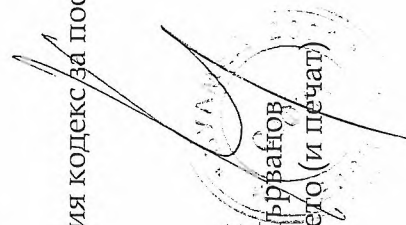

<sup>2</sup> Когато участникът е обединение, тази декларация се подписва от съдружника в обединението, който ще внесе гаранцията за изпълнение на договора, а когато гаранцията за участие се внася от трето лице - декларацията се подписва от него.





София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тодор Боб“ № 21. Тел: 02/9154 211 ; Факс: 02/951 6268. Е-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

Приложение № 2

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ** за изпълнение на поръчката  
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя  
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

От „Булмед 2000“ ЕООД (наименование на участника) с 121268853 (ЕИК/Булстап/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), представявано от Людмил


цена  
ОП  
а  
тве

**ЗАВЪЗДАВАТЕЛСТВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36 А, АЛ. 3 ОТ ЗОП.**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложи в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

1. Участваме за обособена позиция №42

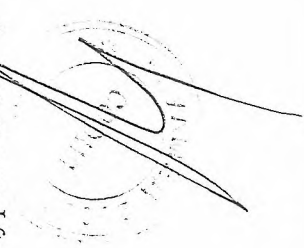



София 1606, р-т „Красно село“, бул. „Тодорбег“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс/02/ 951 6268. E-mail: [pigofov@pigofov.bg](mailto:pigofov@pigofov.bg)

| Номер на номен-клатура | Изисквания на възложителя |                            | Предложения на участника               |                   |   |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|---|
|                        | Описание                  | Опак овка/ Мерн а един ица | Търговско наименование                 | Производител      | Други особености по преценка на изпълнителя |
| 1                      | 2                         | 3                          | 4                                      | 5                 | 6   |
| 1                      | Затварящ конус            | Бр.                        | Stopper closing cone, Luer lock, white | Б.Браун Мелзунген | Кат. №4097076                               |

2. Прилагаме оторизационни писма на името на участника от:
- а/ производителя на съответните медицински изделия и консумативи или
  - б/ от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка със съответните изделия на производителя – заверено от участника копие.
3. Прилагаме сертификати за качество и декларация за съответствие на offerираните медицински изделия и консумативи съгласно изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "CE" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ – заверено от участника копие (посочва се за коя номенклатурна единица се отнасят).
4. Прилагаме проспекти на български език с всички технически показатели и параметри на предлаганите медицински изделия и консумативи и указания за употреба.
5. Предлагаме срок на доставка на медицинско изделие - до 72 (седемдесет и два) часа след подадена от възложителя писмена заявка за доставка, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на доставка, различен от обявения (предлаганият срок не следва да е по-дълъг от 72 часа).



София 1606, р-т „Красно село“, Бул. „Толубен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

6. Към момента на доставянето на медицинско изделие ще е със срок на годност не по-кратък от 75 % от срока на годност, даден от неговия производител, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на годност, различен от обявения.

7. Представяването от мен дружество се задължава да изпълни предмета на обществената поръчка в съответствие с всички действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо:

1. за качествено изпълнение на поръчката, както и

2. за изпълнение на всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

8. Декларирам,<sup>1</sup> че действителният/те собственик/и по смисъла на §2, ал.1 от ДР на ЗМИП на представляваното от мен дружество е /са/ следното физическо лице/ едните физически лица/:

1. Людмил Борисов Първанов,

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.36а, ал. 3 от ЗОП.**

.....  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....  
.....

постоянен адрес .....  
.....


гражданство .....  
.....

документ за самоличност .....  
.....

.....

9. Връзка с чл.66 от ЗМИП<sup>2</sup>декларирам, че

<sup>1</sup> Когато участникът е обединение/консорциум, всички съдружници в обединението/консорциумът посочват кои са действителните собственици на техните дружества в отделни декларации към Техническото предложение.

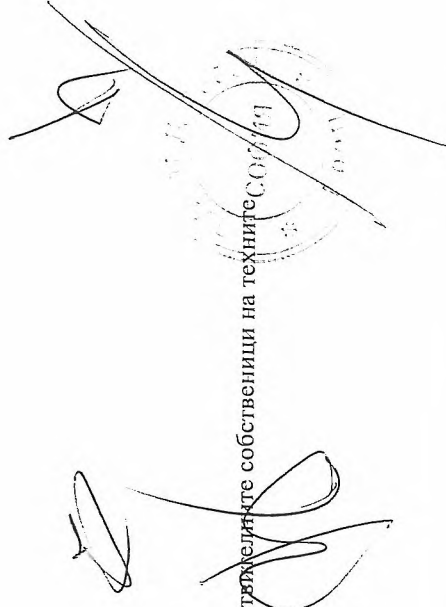

София 1606, р-т „Красно село“, бул. „Горлебен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. Е-mail: [pirigov@pirigov.bg](mailto:pirigov@pirigov.bg)

- Основната дейност на дружеството е търговия с медицинска техника, резервни части за нея, медицински консумативи и материали, сервизно обслужване и ремонт, диагностика и поддръжка на специализирана медицинска техника, информациона и консултантска дейност, маркетинг, лизинг, реклама, търговско представителство, посредничество и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от закона.

паричните средства за изпълнение на обществената поръчка съгласно ценовото ни предложение и за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка имат следния произход: Търговска дейност

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

10. Декларирам, че сме съгласни да получаваме протоколите, решенията, писмата и други документи от Възложителя на електронната поща, която сме посочили в еБЕДОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

11.09.2019г.

дата


Име и фамилия

Людмил Първанов

Подпис на лицею (и печат)



<sup>2</sup> Когато участникът е обединение, тази декларация се подписва от съдружника в обединението, който ще внесе гаранцията за изпълнение на договора, а когато гаранцията за участие се внася от трето лице - декларацията се подписва от него.

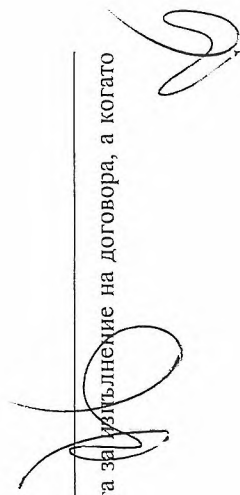

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211, Факс: 02/ 951 6268, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

„Булмед 2000“ ЕООД (наименование на участника) с 121268853 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), представлявано от ~~Петър Бонков Петков~~

**заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.**

обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия за ортопедия и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Предложените от нас цени са следните:

| № на номер-ен-клатура | Търговско наименование * | Производител          | Опаковка/ Мерна единица | Прогноз-но количество за две години | Единична цена в лева без ДДС за опаковка / брой от колона 5 | Стойност в лева без ДДС (колона 5 x колона 6) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1                     | 2*                       | 3                     | 4                       | 5                                   | 6   | 7   |
| 1                     | Coroflex ISAR NEO        | B. Braun Melsungen AG | бр.                     | 288                                 | 375.00  | 108 000.00                                    |
| 2                     | Coroflex Blue NEO        | B. Braun Melsungen AG | бр.                     | 50                                  | 149.17  | 7 458.50                                      |
| 3                     | SeQuent NEO              | B. Braun Melsungen AG | бр.                     | 200                                 | 172.90  | 34 580.00                                     |
| 4                     | SeQuent NEO NC           | B. Braun Melsungen AG | бр.                     | 400                                 | 186.20  | 74 480.00                                     |



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 . Факс: 02/ 951 6268. Е-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

|    |                                   |                               |     |     |         |           |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|-----|-----|---------|-----------|
| 5  | SeQuent Please NEO                | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 100 | 600.00  | 60 000.00 |
| 6  | NSE Alpha                         | Goodman Co LTD                | бр. | 40  | 1129.00 | 45 160.00 |
| 7  | Vascuflex                         | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 100 | 798.33  | 79 833.00 |
| 8  | SeQuent Please OTW 035            | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 50  | 600.00  | 30 000.00 |
| 9  | SeQuent Please OTW 014            | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 50  | 600.00  | 30 000.00 |
| 10 | SeQuent Please OTW 018            | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 150 | 600.00  | 90 000.00 |
| 11 | Navitas                           | Brivant LTD                   | бр. | 100 | 183.00  | 18 300.00 |
| 12 | Serpia                            | PendraCare International B.V. | бр. | 100 | 168.00  | 16 800.00 |
| 13 | Inflation Device                  | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 100 | 94.50   | 9 450.00  |
| 14 | Intradyn Arterial Puncture Needle | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 100 | 2.80    | 280.00    |
| 15 | Angiodyn Drainage set             | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 20  | 275.00  | 5 500.00  |
| 16 | Manifold Softgrip 2-port          | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 500 | 8.78    | 4 390.00  |
| 17 | Manifold Softgrip 3-port          | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 500 | 10.15   | 5 075.00  |
| 18 | Angiodyn Guidewire 175            | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 600 | 27.55   | 16 530.00 |
| 19 | Angiodyn Guidewire 260            | B. Braun Melsungen AG         | бр. | 400 | 58.00   | 23 200.00 |



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Топлобен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211. Факс: 02/ 951 6268. E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

|    |  |                       |     |       |        |           |
|----|--|-----------------------|-----|-------|--------|-----------|
| 20 | Y-connector                            | B. Braun Melsungen AG | бр. | 100   | 40.50  | 4 050.00  |
| 21 | Discofix C-3                           | Б.Браун Мелзунген     | бр. | 2 000 | 4.20   | 8 400.00  |
| 22 | Angiodyn High Pressure Tubing          | B. Braun Melsungen AG | бр. | 200   | 33.75  | 6 750.00  |
| 23 | Celsite PSU                            | B. Braun Medical SAS  | бр. | 200   | 345.83 | 69 166.00 |
| 24 | Celsite Implantofix                    | B. Braun Medical SAS  | бр. | 200   | 306.90 | 61 380.00 |
| 25 | Introcan Safety                        | Б.Браун Мелзунген     | бр. | 4000  | 1.33   | 5 320.00  |
| 26 | Vena Tech Retrievable                  | B. Braun Medical SAS  | бр. | 25    | 858.33 | 21 458.25 |
| 27 | Vena Tech Retrievable Retrieval system | B. Braun Medical SAS  | бр. | 25    | 472.00 | 11 800.00 |
| 28 | Eledyn                                 | B. Braun Melsungen AG | бр. | 50    | 262.00 | 13 100.00 |
| 29 | Combi red                              | B. Braun Melsungen AG | бр. | 3000  | 0.20   | 600.00    |


\*Забележка: В колона 2 „Търговско наименование“ следва да се впише точното наименование на лекарствения продукт/ медицинското изделие така, както е оферирано в „Предложение за изпълнение на поръчката“.

1. Предложената от нас обща стойност за изпълнение на поръчката е, както следва:

1.1. без ДДС 861 060.75 лв. (осемстотин шестдесет и една хиляди и шестдесет лева и 0,75 стотинки);

1.2. с ДДС 1 033 272.90 лв. (един милион тридесет и три хиляди двеста седемдесет и два лева и 0,90 стотинки).

2. Единичните цени са оферирани с точност до втори знак след десетичната запетая.

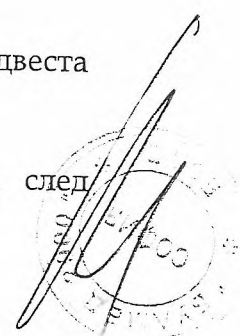

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 . Факс: 02/ 951 6268. Е-мил: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)


3. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, изразяваме съгласие заплащането за извършваните от нас доставки да е в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от възложителя на оригинална данъчна фактура, придружена с приемо-предавателен протокол.

5. Други предложения

.....

Дата: 11.09.2019 г.

Подпис: .....

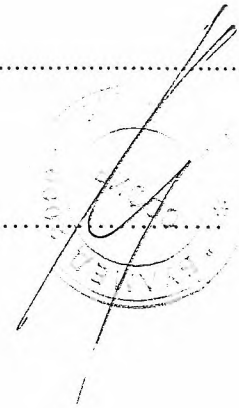


A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Bulgarian, including 'УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА' and 'ПИРОГОВ'. The signature is a stylized, cursive script.

## Обособена позиция 34

| № | Описание  | Марка | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Търговско Наименование | Каталожен номер  | Производител             | Ед.цена | Обща стойност |
|---|---|-------|---|------------------------|--|--------------------------|---------|---------------|
| 1 | Меднамамент излъчващ коронарен стент от кобалт-хром без полимер в покритието, с биоерозибруема матрица от Сирилимус – 1.2 µg/мм <sup>2</sup> и Пробукол [50:50]; с аблуминално rollmer-free покритие, подпомагащо бързата ендотелиализация; със страт – 85 µm (при диаметри 2.0-3.0 мм) и 65 µm (при диаметри 3.5-4.0 мм); с висока гъвкавост и висока проходливост; с отворен клетъчен диаметър: дължина 145 см; с профил на входа на лезията 0.016" (0.41 mm); с профил на преминаване (crossing profile) – 0.031" - 0.038" (0.79 mm – 0.96 mm); с проксимален шaft 1.9F; с дистален шaft 2.5F; съвместим с водещ катетър 5F/ "kissing balloon"; бF; съвместим с водач 0.014" (0.36 mm); номинално налягане 10atm, RFR 18atm; с размери: диаметри 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm с дължина 9mm, 12mm, 16mm, 19mm, 24mm, 28mm, 32mm, 38mm | бр.   | 288   | CoroFlex ISAR NEO      | 5028910-5028965  | B. Braun<br>Melsungen AG | 375.00  | 108 000.00    |
| 2 | Коронарен стент от кобалт-хромиева сплав L605 с по-малко от 30 % съдържание на ниел; дебелина на страта 60 µm; дизайн: Девет корони с три свързващи мостчета, отворен клетъчен диаметър (0.9 mm -1.3 mm); профил на входа на лезията 0.016"; проксимален шaft 1.9F, проксимирание на балона по-малко от 0.5 mm от всяка страна; профил на преминаване: 2.75 mm – 0.033", 3.0 mm – 0.034", 3.5 mm – 0.035", 4.0 mm – 0.035"; размери : Диаметри 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm с дължина 8 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 24 mm, 27 mm и 32 mm  | бр.   | 50  | CoroFlex Blue NEO      | 5029012-5029085  | B. Braun<br>Melsungen AG | 149.17  | 7 458.50      |
| 3 | RTSA балон катетър, материал SOMAX; четиристранно съннат; нисък профил на върха - 0.016"; дължина 145 см, проксимален шaft 1,9 F, дистален шaft 2,5 F, НРТС – система, улесняваща добрата навигация; съвместим с 5F водещ катетър; съвместим с водач 0.014"; специално покритие улесняващо припльването; hard-soft връх; наличен и в диаметри 1.25 и 1.5, подходящи за лечение на хронични тотални оклузии; размери: диаметри 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm с дължина 10mm, 15mm, 25mm, 30mm и диаметри 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm с дължина 20mm   | бр.   | 200   | SeQuent NEO            | 5021711-5021759  | B. Braun<br>Melsungen AG | 172.90  | 34 580.00     |
| 4 | Non-compliant балон катетър, материал Nylon; четиристранно съннат; нисък профил на върха - 0.016" (0.41mm); дължина 140 см, проксимален шaft 1,9 F, дистален шaft 2,7 F, НРТС – система, улесняваща добрата навигация; съвместим с 5F водещ катетър; съвместим с водач 0.014"; брахивален и феморален маркер 90 смБ 100см; подходящ за подготовка на лезията и постдилатация под високо налягане; размери: диаметри 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm с дължини 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 30mm  | бр.   | 400   | SeQuent NEO NC         | 5023900-5023968  | B. Braun<br>Melsungen AG | 186.20  | 74 480.00     |
| 5 | Павликсел излъчващ РТСА балон катетър с матрично покритие от Facitaxel и Lortomide с проксимален шaft – 1.9F, дистален шaft – 2.5F, дължина – 145 см, брахивален и феморален маркер – 100 см и 110 см, съвместим с водещ катетър 5F, съвместим с водач 0.014", профил на върха – 0.016", профил на преминаване: 0.031" - 0.033", номинално налягане: 6 atm., максимално налягане: 14 atm., размери: диаметри 2.0mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm с дължина 10 мм, 15mm, 20 / 17mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm   | бр.   | 100   | SeQuent Please NEO     | 5023200-5023267  | B. Braun<br>Melsungen AG | 600.00  | 60 000.00     |
| 6 | Балон с 3 скоринг елемента от найлон за ефективна подготовка на лезията, проксимален шaft 2.1 F, дистален шaft 2.7 F, съвместимост с водач 0.014", номинално налягане 6 atm., дължина 13 мм, диаметри 2 мм, 2.25mm, 2.5mm, 2.75 мм, 3mm, 3.5 мм, 4 мм   | бр.   | 40  | NSE Alpha              | NSA20013<br>NSA22513<br>NSA25013<br>NSA27513<br>NSA30013<br>NSA35013<br>NSA40013 | Goodman Co<br>LTD        | 1129.00 | 45 160.00     |
| 7 | Периферен саморазваещ се ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии и SFA от Нитинол. С дизайн "отворена клетка", с двойно полиран страт; с лазерно спонни танталови маркери за прецизно позициониране; с рентгенопозитивни платинени маркери; Система 5F, съвместима с водач 0.018" и система 6F, съвместима с водач 0.035"; диаметър на стената 5-10mm; дължина на стената 20-200mm; дължина на шafta 80cm и 120/130cm; наличен и с размер на шafta 180cm за трансрадиален/ трансбрахиален достъп; специална LRF (Low Radial Force) версия  | бр.   | 100   | Vascuflex              | 5505000-5506315  | B. Braun<br>Melsungen AG | 798.33  | 79 833.00     |

|    |   |     |       |                                   |                         |                               |        |           |
|----|---|-----|-------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
| 8  | Медикамент излъчващ периферен балон, с Пакилтаксел 3mg/мм <sup>2</sup> в матрица с Ресерватрол, с катетър OTW, съвместим с периферен водач 0.035", с дължина на катетъра 75 см/130см; semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Rebax; с профил на входа на лезията 4.0мм; 0.04"/1.04мм, 5.0-7.0мм; 0.04"/1.18мм, 8.0мм; 0.04"/1.30мм; с кросинг профил 4.0мм; 0.0650"/1.65мм, 5.0-7.0мм; 0.0709"/1.80мм, 8.0мм; 0.0715"/1.82мм; с размери: 1. На шaft 75 см. Диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, диаметри 7.0-8.0мм с дължини 40мм и 60мм; 2. На шaft 130 см. Диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм   | 6p. | 50    | SeQuent Please OTW 035            | 35040040-35360150       | B. Braun Melsungen AG         | 600.00 | 30 000.00 |
| 9  | Медикамент излъчващ периферен балон, с Пакилтаксел 3mg/мм <sup>2</sup> в матрица с Ресерватрол, кс аетър OTW, да е съвместим с периферен водач 0.014", да е с дължина на катетъра 130см, да е semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Rebax; с профил на входа на лезията 0.0181"/0.46мм; с кросинг профил 1.5мм; 0.0374", 2.0мм; 0.0413", 2.5мм; 0.0453", 3.0мм; 0.0453", с размери: диаметър 1.5мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, диаметри 2.0-3.0мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, 150мм  | 6p. | 50    | SeQuent Please OTW 014            | 14215040-14230150       | B. Braun Melsungen AG         | 600.00 | 30 000.00 |
| 10 | Медикамент излъчващ периферен балон, с Пакилтаксел 3mg/мм <sup>2</sup> в матрица с Ресерватрол, катетър OTW, да е съвместим с периферен водач 0.018", с дължина на катетъра 75см и 130см; semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Rebax; с тръбно стъпък, съвместим с шийт от 2мм до 4мм с 4F и от 5мм до 6мм с 5F мм; с размери: за 75мм, диаметри 3.5мм, 4мм, 5мм и 6мм с дължини между 40мм и 120мм, за 130см, диаметри 2мм, 2.5мм, 3мм, 3.5мм, 4мм, 5мм, 6мм с дължини между 40мм и 120мм  | 6p. | 100   | Navitas                           | 100-000-000-903-000-010 | B. Braun Melsungen AG         | 183.00 | 18 300.00 |
| 11 | Водач за PTCA 195 ст 0.014", J и прав връх, хидрофилно покритие, 3 см рентгенпозитивна намотка, различни степени на гъвкавост на върха, СТО разновидности (3/6/9/12 гр.)  | 6p. | 100   | Navitas                           | 100-000-000-903-000-010 | B. Braun Melsungen AG         | 183.00 | 18 300.00 |
| 12 | Коронарен водач катетър с авраматичен дистален мек връх, хидрофилно покритие на шaft, отлична издръжливост при огъване, 1:1 движение с торкер, голям вътрешен лумен – 0.071" при 6F, размери: 5F в конфигурации: AL1, HS, JL3.5, JL4, JR3.5, JR4, MPA, RAD, TIG2, XB3.5, XB4, EBU3.5, EBU3.75, EBU4; 6F в конфигурации: AL1, AL1 SH, AL1.5, AL1.5 SH, AL2, AL2 SH, AR1, AR1 SH, AR2, AR2 SH, HS, IM, JM SH, JL3.5, JL3.5 SH, JL4, JL4 SH, JL5, JL5 SH, JR3.5, JR3.5 SH, JR4, JR4 SH, JR4.5 SH, JR5, MPA, MPA SH, RAD, RBX, XB3, XB3.5 SH, XB4, XB4 SH, XB4.5, EBU3 SH, EBU3.5, EBU3.5 SH, EBU3.75 SH, EBU4, EBU4 SH, 7F в конфигурации: AL1 SH, AL2 SH, AL3 SH, AR1 SH, AR2 SH, HS SH, JL3 SH, JL3.5 SH, JL4 SH, JL4.5 SH, JL5 SH, JR3.5 SH, JR4 SH, JR4.5 SH, JR5 SH, MPA SH, EBU3 SH, EBU3.5 SH, EBU3.75 SH, EBU4 SH, EBU4.5 SH | 6p. | 100   | Serpla                            | 25400205-27409225       | PendraCare International B.V. | 168.00 | 16 800.00 |
| 13 | Инфлуационна манометър спринцовка за PTCA; обем 25 мл; до 30 атмосфери; с 30 см линия за високо налягане с трипътно спирателно кранче; лесно заключващ се механизъм с крилца  | 6p. | 100   | Inflation Device                  | 5028901                 | B. Braun Melsungen AG         | 94.50  | 9 450.00  |
| 14 | Пункционна игла 18 G 7 см   | 6p. | 100   | Intradyn Arterial Puncture Needle | 5208505                 | B. Braun Melsungen AG         | 2.80   | 280.00    |
| 15 | Дренажен сет. Сет за перикардицентеза с включена пункционна игла 18G, 120 мм. Съдържа: Пункционна игла 18G, 120 мм, Дренажен катетър с мандрен, Дилатор F6 с разцепващи се интродусерни маншети, Канюла размер 0.9x70мм, Скалпел за еднократна употреба, Торбичка за секрет с обем 1500 мл, Помпено устройство, Спринцовка с луер-лок 50мл, Спринцовка с луер-лок 10мл, Диагностичен водач J3, Покривна кърпа   | 6p. | 20    | Angiodyn Drainage set             | 5213300<br>5213303      | B. Braun Melsungen AG         | 275.00 | 5 500.00  |
| 16 | Двупътно кранче /Многопътник/ Двупътно кранче за високо налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна, ON и OFF версия   | 6p. | 500   | Manifold Softgrip 2-port          | 5010576                 | B. Braun Melsungen AG         | 8.78   | 4 390.00  |
| 17 | Трипътно кранче /Многопътник/ Трипътно кранче за високо налягане /до 70 bar/, с ротиращ адаптор разположен от дясната страна, ON и OFF версия   | 6p. | 500   | Manifold Softgrip 3-port          | 5010575                 | B. Braun Melsungen AG         | 10.15  | 5 075.00  |
| 18 | Диагностичен водач с PTFE покритие от неръждаема никел-хромиева сплав, с диспенсер и луер лок фитинг, J-тип, 0.035", 175см, гъвкав и гладко заоблен връх на водача.   | 6p. | 600   | Angiodyn Guidewire 175            | 5059755                 | B. Braun Melsungen AG         | 27.55  | 16 530.00 |
| 19 | Диагностичен водач с PTFE покритие от неръждаема никел-хромиева сплав, с диспенсер и луер лок фитинг, J-тип, 0.035", 260см, гъвкав и гладко заоблен връх на водача.   | 6p. | 400   | Angiodyn Guidewire 260            | 5050359                 | B. Braun Melsungen AG         | 58.00  | 23 200.00 |
| 20 | Y-колектор - единичен Y-колектор, лумен 9.5F, с ротиращ адаптор   | 6p. | 100   | Y-connector                       | 5021693                 | B. Braun Melsungen AG         | 40.50  | 4 050.00  |
| 21 | Удължител 50 см + трипътно кранче   | 6p. | 2 000 | Discofix C-3                      | 16540C                  | B. Braun Melsungen AG         | 4.20   | 8 400.00  |

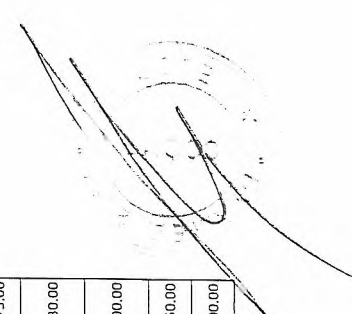

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.



|    |  |     |      |                               |   |                          |        |           |
|----|--|-----|------|-------------------------------|---|--------------------------|--------|-----------|
| 22 | Удължител за подаване на контрастна материя под налягане с наконечник тип Luer-Lock, устойчив на високо налягане(1425PSI) с размери: Дължина 60, 90, 120, 150 cm   | бр. | 200  | Angiodyn High Pressure Tubing | 5011507<br>5011515<br>5011523<br>5011531<br>5016002     | B. Braun<br>Melsungen AG | 33.75  | 6 750.00  |
| 23 | Система за венозен достъп Пот-а-Кат от полисулфон с титаниева камера, стандартна камера с размери 35x22мм, височина 13.2мм, дължина на мембраната 1.2мм, малка камера 30x22мм с височина 10.6мм с дължина на мембраната 9.5мм, силиконов или PUR катетър 6.5F и 8.5F, с включен сет по Селдингер.  | бр. | 200  | Celsite PSU                   | 4430433<br>4430425                                      | B. Braun<br>SAS          | 345.83 | 69 166.00 |
| 24 | Система за венозен достъп Пот-а-Кат от полисулфон без титаниева камера, стандартна камера с размери 38x25мм, височина 11.5мм, дължина на мембраната 1.2мм, малка камера 32x22мм с височина 11мм с дължина на мембраната 8мм, силиконов или PUR катетър 4.5F ; 5F и 6F, с включен сет по Селдингер.   | бр. | 200  | Celsite Implantofix           | 4430263<br>4438604<br>4438704<br>4438647<br>4438747     | B. Braun<br>SAS          | 306.90 | 61 380.00 |
| 25 | Периферни венозни катетри, без допълнителен порт. Катетър от полиуретан, с атраматичен профил и 4 вградени рентгенопозитивни линии. Тънкостенна игла за бързо изтичане на кръв, с вграден хидрофобен филтър и триплостно заточване за лесна перфорация на кожата. Прозрачна камера за контрол на изтичането на кръв. Със и без крилица с дупки за укрелване с конект. Автоматичен (пасивен), изцяло метален предпазен механизъм, покриващ върха на иглата след изваждане от катетъра. Цветен код за размера. Размери от G 14 до G20.                             | бр. | 4000 | Introcath Safety              | 4253639-01;<br>4253612-01;<br>4253590-01;<br>4253566-01 | Б.Браун<br>Мелзунген     | 1.33   | 5 320.00  |
| 26 | Временен Вена Кава филтър, предварително зареден във въвеждаща спринцовка, за югуларен и за феморален достъп, материал финокс – неферромагнитна слава изцяло видима под рентгенови лъчи и идеално съвместима с изобразяване с магнитен резонанс, с 8 стабилизиращи крачета с кучкици на четири нива, ефективни коничен дизайн, Дължина на конуса 40 мм, височина 53 мм, за използване при Вена Кава с диаметър ≥14 mm и ≤28 mm, в комплект с F7 интродюсер с хемостатична игла, J-водач с PTFE покритие с дължина 1500мм и диаметър 0.035", късо и дълго бутало. | бр. | 25   | Vena Tech Retrievable         | 4435150   | B. Braun<br>SAS          | 858.33 | 21 458.25 |
| 27 | Сет за премахане на временен Вена Кава филтър през дясна Вена Югуларис Интерна, за използване при филтър от финокс с 8 стабилизиращи крачета с кучкици на четири нива, коничен дизайн с дължина на конуса 40 мм, височина 53 мм, за използване при Вена Кава с диаметър ≥14 mm и ≤28 mm  | бр. | 25   | Vena Tech Retrieval system    | 4435170   | B. Braun<br>SAS          | 472.00 | 11 800.00 |
| 28 | Биполарен електрод за временна трансвенозна кардиостимулация – с балон<br>- материал на електродите – неръждаема стомана<br>- Дължина на електрода 3 мм;<br>- разстояние на електродите – 10 мм;<br>- Дължина 110 см;<br>- материал на катетъра – антиромбогенен Полиуретан<br>- маркер на всеки 100 мм от върха на катетъра<br>- не съдържа PVC<br>- с включена еднократна спринцовка със стопер за прецизно раздуване на балона<br>- размер – 5F   | бр. | 50   | Eledyn                        | 5101506   | B. Braun<br>Melsungen AG | 262.00 | 13 100.00 |
| 29 | Тапа за венозен катетър/система. Двоен накрайник (мъжко/женско), поддържаща за венозни катетри и интравенозни системи. В самостоятелна стерилна опаковка.  | бр. | 3000 | Combi red                     | 4495101   | B. Braun<br>Melsungen AG | 0.20   | 600.00    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21. Тел: 02/9154 211, Факс: 02/951 6268, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

### Приложение № 3

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От  
„Булмед 2000“ ЕООД (наименование на участника) с 121268853  
(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие  
със законодателството на държавата, в която участникът е установен),  
представявано от Людмил Борисов Първанов (имената на законния или

**заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.**

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за  
ортопедия и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна  
кардиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И.  
Пирогов“ ЕАД,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предложенията от нас цени са следните:

| № на<br>на<br>ном<br>ен-<br>кла<br>ту-<br>ра | Търговско<br>наименование<br>*               | Производител             | Опаковка<br>/<br>Мерна<br>единица | Прогноз-но<br>количество<br>за две<br>години | Единич-<br>на цена<br>в лева<br>без ДДС<br>за<br>опаковка<br>/<br>брой<br>от<br>колона 5 | Стойнос<br>т в лева<br>без ДДС<br>(колона<br>5 x<br>колона<br>6) |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1  | 2*   | 3                        | 4                                 | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Stopper closing<br>cone, Luer lock,<br>white | B. Braun<br>Melsungen AG | бр.                               | 2000   | 0,12   | 240,00   |

\*Забележка: В колона 2 „Търговско наименование“ следва да се впише точното  
наименование на лекарствения продукт/ медицинското изделие така, както е  
оферирано в „Предложение за изпълнение на поръчката“.

1. Предложената от нас обща стойност за изпълнение на поръчката е, както  
следва:

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Гетлебен“ № 21. Тел: 02/9154 211 . Факс: 02/951 6268. Е-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

1.1. без ДДС 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева);

1.2. с ДДС 288,00 лв. (двеста осемдесет и осем лева).

2. Единичните цени са оферирани с точност до втори знак след десетичната запетая.

3. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, изразяваме съгласие заплащането за извършваните от нас доставки да е в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от възложителя на оригинална данъчна фактура, придружена с приемо-предавателен протокол.


5. Други предложения

.....

.....

Дата: 11.09.2019 г.

Подпис: .....

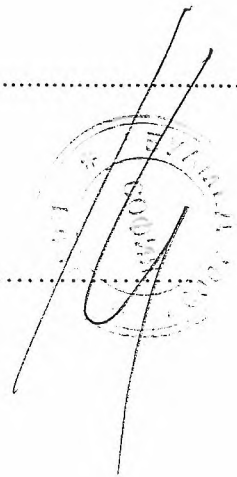

Обособена позиция 42

| № | Описание       | Марка | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Търговско Наименование                 | Каталожен номер | Производител      | Единица      | Обща стойност |
|---|----------------|-------|---|--|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 1 | Затварящ конус | бр.   | 2 000   | Stopper closing cone, Luer lock, white | 4 097 076       | Б.Браун Мелзунген | 0.12         | 240.00        |
|   |                |       |   |  |                 |                   | <b>ОБЩО:</b> | 240.00        |