

ДОГОВОР

00-01-35 / 28.01.2020 г.

Днес, 28.01.2020, в гр. София между:

1. „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД, с ЕИК 130345786, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, представлявано от Проф. д-р Асен Балтов, д.м., в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

и

2. „АКВАХИМ“ АД, с ЕИК 200984964, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 83, представлявано от Камелия Трендафилова Цанкова, в качеството си на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

на основание утвърден протокол от 24.01.2020 г. на Възложителя и във връзка с проведена обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Закупуване на оборудване за хистологични лаборатории“, по 3 обособени позиции, открита с Обява № РД-44-68/06.01.2020 г., се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема съгласно условията на този договор, да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на медицинска апаратура, съгласно техническа спецификация, техническо предложение и ценово предложение неразделна част от настоящия договор.

(2) При изпълнението на задължението по горната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на Техническата спецификация от тръжната документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото и Ценово предложения от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № 1, 2 и 3 към настоящия договор).

(3) Изпълнението на задължението по ал. 1 включва доставка, монтиране, инсталиране и пускане в експлоатация, обучение на персонала, както и гаранционно поддържане на доставеното оборудване; поддържане на непрекъсваемост и осигуряване на организационно, финансово, техническо и кадрово обезпечаване на работата на апаратурата.



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до изтичането на срока на гаранционно поддържане.


(2) Гаранционният срок е **12 /дванадесет/ месеца**, считано от датата на приемо-предавателния протокол за доставка, монтаж, пускане в експлоатация на оборудването и обучение на персонала.

Чл. 3. Срокът за доставка е до 10 дни, считано от сключване на договора и направена заявка. Срокът за монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала е съгласно Техническото предложение по съответната обособена позиция.

III. ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. (1) Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Да изпълнява дейностите по чл. 1 в съответствие с указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискванията на МЗ и приложимото национално и общностно законодателство;
2. Да обучи експертите, притежаващи образование и професионален опит, гарантиращи качествено изпълнение на дейностите по чл. 1;
3. Да изпълнява дейностите по чл. 1, като полага дължимата грижа за качествено осъществяването на предмета на договора по най-високите стандарти на професионална компетентност;
4. Писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всяко събитие или факт, които са във връзка с неговата дейност по настоящия договор или които биха могли да имат негативен ефект върху изпълнението на проекта, или които могат да затруднят или забавят изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора;
5. Да заплаща за своя сметка евентуално наложените във връзка с експлоатацията на апаратурата и провеждане на дейността с нея имуществени санкции (глоби и др.) от съответните органи и институции.
6. Да заплаща за своя сметка евентуално присъдените от съответните съдебни органи и други институции във връзка с експлоатацията на апаратурата, имуществени обезщетения на увредени лица.

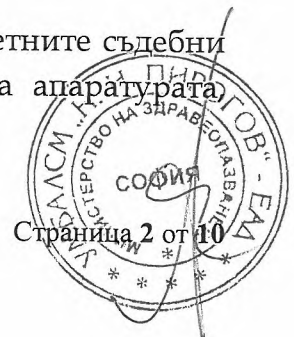

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

7. Да заплаща за своя сметка появилите се дефекти или повреди, в това число при необходимост да осигури друг апарат.

(2) Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи в срок уговореното възнаграждение;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими му за качественото извършване на доставките по този договор;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи копие от материали, изготвени по този договор.

Чл. 5. (1) Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на дейностите, възлагани по реда на този договор;
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уточнява въпросите, свързани с изпълнението на дейности, възлагани по реда на този договор, при поискване и със съдействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме предоставеното оборудване в сроковете и условията, уговорени в настоящия договор, ако то отговаря на изискванията на договора;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в срок;
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи;
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава във всички случаи, при изпълнението на предмета на настоящия договор, да пази доброто име и репутация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни дейностите по чл. 1 от договора, в срок и без отклонения от договорените изисквания.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация по отношение на доставеното по Договора оборудване, съгласно гаранционните му условия.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за доставката, монтирането, инсталирането и пускане в експлоатация на оборудването, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Оборудването се доставя, монтира и инсталира на местата за инсталиране, посочени и потвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е посочил в офертата си специални условия относно средата на инсталиране, се счита, че такива не са необходими или че те следва да бъде осигурени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави, монтира, инсталира и пусне в експлоатация оборудването в рамките на 10 (десет) дни, считано от влизането в сила на настоящия договор и направена заявка.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уточни подробностите, касаещи транспортирането, разполагането и инсталирането на оборудването и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5 (пет) дни предварително за точната дата и час, в които той възнамерява да изпълни възложените задачи.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава местонахождението на местата за инсталиране след получаване на уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно ал. 1.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че персоналят, необходим от негова страна е уведомен и ще присъства по време на доставката и инсталирането.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна в местоположението на местата за инсталиране не по-късно от 5 (пет) дни преди очакваната дата на доставката.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че оборудването, което трябва да се предостави, се придружава от съответната документация на български език, като например ръководства на потребителя, както и от оперативни ръководства или чертежи, които трябва да бъдат достатъчно подробни, така че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите служители сами или с помощта на съответни специалисти да могат да активират, поддържат, настройват или ремонтират, в зависимост от случая, оборудването и в бъдеще.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да организира транспортирането и разтоварването на оборудването от транспортните средства в мястото на инсталиране „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД.

(2) Изпълнителят се задължава да поеме всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоките до местата за инсталиране и има задължението да освободи стоките за износ и/или внос, както и да заплати акциз, както за износ така и за внос, и да извърши всички митнически формалности, ако е приложимо.

Чл. 11. (1) Приемането на оборудването се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол.

(2) Успешното завършване на монтажа, инсталацията и изпитванията на оборудването се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за монтаж и инсталация на оборудването без забележки.

(3) Успешното пускане в експлоатация на оборудването се удостоверява с подписването на двустранен протокол за пускане в експлоатация на оборудването без забележки.

(4) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

V. ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, за собствена сметка да поддържа и обслужва оборудването, предмет на договора, в рамките на срока на действие на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването при спазване на условията, описани в съответната техническа документация на оборудването.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по собствено усмотрение да отправя заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на възникнала повреда на оборудването. Заявката се отправя писмено (включително и по електронен път) до:



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Адрес: гр. София 1582, район р-н Искър, "Проф. Цветан Лазаров" No 83;

Факс: +359 (02) 807 5050; тел: +359 (02) 807 5000;

Адрес на електронна поща: aquachim@aquachim.bg

(2) Заявката трябва да съдържа информацията за: повредата, часа и датата, когато е констатирана и вероятния характер на повредата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да реагира и отстрани възникналата повреда в сроковете и условията от Техническото му предложение.

Чл. 14. (1) В случай че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по – добри характеристики. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Всички вложени резервни части на оборудването, в рамките на срока на действие на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва за своя сметка профилактични технически прегледи на предоставеното оборудване, съобразно препоръките на производителя и нормативните изисквания за съответния тип апаратура, но не по-малко от веднъж на 3 (три) месеца, в рамките на срока на действие на настоящия договор.

VI. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на **66 000,00 лева (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС** или **79 200,00 лева (седемдесет и девет хиляди и двеста лева) с включен ДДС**, съответно по Обособена позиция № 1 – 14 000,00 лв. (четиринадесет хиляди лева) без ДДС ; Обособена позиция № 2 – 31 000,00 лв. (тридесет и една хиляди лева) без ДДС и Обособена позиция № 3 – 21 000,00 лв. (двадесет и една хиляди лева) без ДДС, съгласно Ценови предложения – Приложение № 3, неразделна част от настоящия Договор.

(2) Възложителят заплаща цената по алинея 1 в срок до *60 (шестдесет)* календарни дни след представяне на редовна фактура и подписан от представители на двете страни без забележки приемо предавателен протокол за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала.



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Чл. 16. (1) Всички плащания по настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банков път по следната сметка в лева на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Титуляр: „АКВАХИМ“ АД

БАНКА: Прокредит Банк АД

IBAN: BG38 PRCB 92301050403301; BIC: PRCBVBGSF

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
 2. При виновно неизпълнение на съществено задължение на една от страните по договора, което е неотстранимо или не е отстранено след предупреждение от другата страна, със седемдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
 3. С прекратяване на дружеството, консорциума, съответното юридическото лице, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 4. С изтичане на срока, за който е сключен.
 5. При наличие на императивни разпоредби и основания в закона.
- (2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:
- (i) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
 - (ii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
 - (iii) при забава продължила повече от 20 (двадесет) дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на оборудването, и/или за обучение на персонала на Възложителя.
- (3) С едностранно писмено предизвестие от страна на Възложителя.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Топлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Чл. 18. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет на сто) % от сумата по чл. 15, алинея 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 5 (пет на сто) % от цената на Договора без ДДС.

(2) Ако забавата продължи повече от 10 (десет) дни, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% (десет процента) от сумата по чл. 15, алинея 1 без ДДС.

(3) При частично неизпълнение или лошо/некачествено изпълнение на възложената работа, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от сумата по чл. 15, алинея 1 без ДДС.

(4) При пълно неизпълнение на възложената работа, вкл. на задълженията за гаранционно поддържане и/или гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 40% (четиридесет процента) от сумата по чл. 15, алинея 1 без ДДС.

(5) При забава на плащането Възложителя дължи на Изпълнителя обезщетение в размер на законната лихва за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на забавеното плащане без ДДС.

(6) Дължимите неустойки, уговорени в настоящия раздел, не лишават страните от възможността да търсят обезщетение за вреди в по-голям размер по общия исков ред.

(7) Неустойките могат да се прихващат от дължимото плащане или от гаранцията за изпълнение на договора.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (две на сто) от общата стойност на договора без ДДС, а именно: 1 320,00 лв. /хиляда триста и двадесет лева/, със срок на валидност 30 календарни дни след изтичане срока на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение се внася преди подписване на договора и се освобождава в пълен размер в срок до 30 календарни дни след изтичане срока на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение или част от нея служи за обезщетение, ако изпълнението е неточно, частично и/или лошо, при пълно или при забавено



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

изпълнение на задължение, с което са причинени вреди на Възложителя. Размерът на удържаната част се равнява на размера на претърпените вреди.

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) В случаите по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. Изменения и допълнения на договора се извършват в писмена форма при наличието на съгласие на страните по него и в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Чл. 21. (1) Всички съобщения между страните по този договор се извършват в писмена форма.

(2) Писмената форма се счита за спазена и когато съобщенията са отправени по факс, електронна поща или чрез лицензирани/регистрирани пощенски оператори.

Чл. 22. (1). Адресите за кореспонденция на страните по договора са, както следва:

1. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД

Лица за контакт: Инженер поддръжка на медицинска техника, Отдел "СТУ"

Адрес за контакти: гр. София, бул. Тотлебен № 21

Тел.: 02 9154 444; 0882 480 019

e-mail: dimitur.stamboliyski@pirogov.bg

2. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „АКВАХИМ“ АД

Адрес за кореспонденция: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 83,

тел. 02 9154581, факс 02 9549861,

e-mail: aquachim@aquachim.bg



София 1606, р-н „Красно село“, Бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

(2) При промяна на посочените данни всяка от страните е длъжна да уведоми другата незабавно.

(3) В случай, че някоя от страните не изпълни задълженията си за уведомяване, съобщенията изпратени на известния адрес, ще се считат за надлежно изпратени и получени.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. За неуредените от договора въпроси се прилага българското законодателство.

Чл. 24. Неразделна част от настоящия договор представляват:

1. Техническа спецификация;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

1

ВЪЗЛОЖИЛ

Проф. Д-р. /

Изпълнител

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

1. на хартиен носител на български език - каталози, проспекти, брошури, сертификати или друг вид документ, от съдържанието на които да са видни техническите характеристики на оферираното Оборудване,

и/или

2. точна/хипервръзка/ към интернет адреса на официалния сайт на производителя на Оборудването, откъдето да са видни техническите характеристики на конкретния офериран артикул.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Автоматична система за почистване на вода от примеси

Електрическо захранване - 220-230V	230 volts ~ / 50 Hz.
Производителност при 25°C минимум 30-35л	40 литра/час
Производителност при 10°C - мин. 15 л/час	Минимум 20 литра на час
Вид смола - йонообменна смола с размери -0,5 мм на частиците	Йонообменна смола с частици с размери -0,5 мм
Обем на смолата - не повече от 0.80 литра	0.75 литра
Максимална температура на водата до 38°C	38°C
Максимална твърдост без защита -40 °f de TH	40 °f de TH

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Допустимо рН от 3-10	3 до 11
Min/max налягане между 2 и 6 bars	2/6 bars
Електропроводимост	≤ 1 μS
Възможност за работа на мембраната с ниско налягане, проектирано за работа без промиване	
Системата да работи с мембрана за обратна осмоза с производителност 300GPD	

2. Автоматизирана система за екстракция на нуклеинови киселини

Модул за пречистване и извличане на нуклеинови киселини от различни клинични проби, включително пълна кръв, серум, плазма, тампони, урина и др	Система за извличане и пречистване на ДНК или РНК от клинични проби - пълна кръв, серум, плазма, тампони, урина и др.
Капацитет - до 16 проби	Обработка от 1 до 16 клинични проби едновременно с предварително програмирани протоколи за получаване на възпроизводим резултати
Температурен диапазон - 15 -30°C	15-30°C обхват за работа с клинични проби
Диапазон на влажност минимум 20-70%	20-80% влажност без конденз
Възможност за UV стерилизация	15 минути цикъл
Нагриване на блока - минимум 40-85 °C	Нагриване на блока в температурен обхват от 40 до 90 °C
Охлаждане на блока при 6°C	Наличие на охлаждане на блока при 6°C
Допълнителен софтуер, съвместим за свързване и работа с EXICYCLER96	Оперативен софтуер за връзка с Exicycler96



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Наличие на графичен LCD сензорен дисплей	LCD сензорен дисплей
Входно напрежение 220-240 VAC	240VAC, 50/60 Hz

3. Автоматичен универсален ротационен микротом

Съвременен мултифункционален микротом, който може да бъде използван в полуавтоматичен или напълно автоматичен режим на работа.

Прецизен стъпков мотор за придвижване на пробата.

Безопасно стартиране със задължително натискане на два бутона едновременно.

Лесно и бързо застопоряване / заключване.

Придвижване напред и ретракция с възможност за две скорости (Нормална и Бърза).

Лесна и бърза настройка скоростта на рязане ((Нормална и Бърза).

Автоматична ретракция с възможност за настройка на дебелината.

Динамичен контрол на скоростта на рязане с помощта на прецизен педал.

Вградена система "HNS" с противотежест за балансирано подпомагане на движението на маховика при ръчно рязане за предпазване от преумора на лаборанта.

Държач за микротомните ножчета с вградена защита и безопасна подмяна.

Латерално движение на държача с три зададени позиции, съобразени с размера на стандартни касети.

Индикатор за позицията на държача в милиметри.

Вграден LCD екран и допълнителен дистанционен контрол, който може да бъде разположен свободно в ляво или дясно за удобство на лаборанта.

Вградена подсветка за възможна проверка качеството на среза.

Автоматично отключване на ръкохватката за преход от ръчно към автоматично рязане.

Ергономична ръкохватка с възможно бързо заключване във всяко едно положение за предотвратяване на инцидентно движение, което може да бъде опасно за оператора.

Държачи за стандартни или макро касети с универсална клампа с бързо застопоряване и лесно освобождаване.

Прецизна ориентация на спесимена с нулева позиция и регулиране от 0° до 8° .

Поставка с антишлъзгащо покритие.

Аварийен СТОП ключ.

Голяма и лесна за работа тавичка за събиране на отпадъците.

Стабилен и масивен корпус за изключително прецизна работа.

Настройка на дебелината на срезите: 0,5 – 100 микрона обхват

0.5 – 5 микрона през стъпка от 0,5 микрон

0.5 – 20 микрона през стъпка от 1 микрон

20 – 30 микрона през стъпка от 2 микрона

30 – 60 микрона през стъпка от 5 микрона

60 – 100 микрона през стъпка от 10 микрона



София 1506, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е-mail: pirogov@pirogov.bg

Настройка дебелината на подрязване: 1 – 600 микрона обхват
5 – 30 микрона през стъпка от 5 микрона
30 – 100 микрона през стъпка от 10 микрона
100 – 200 микрона през стъпка от 20 микрона
200 – 600 микрона през стъпка от 50 микрона

Хоризонтално придвижване 30 mm +/- 1 mm, прецизен стъпков мотор
Вертикално движение 70 mm

Рязане тип Единично, Серийно или
Продължително (при автоматична работа)
Ориентация на спесимена хоризонтално: 8°, вертикално: 8°,
ротация: 360°;

Макс. Размер на спесимена (ШхД) 55 x 50 mm (68 x 50 mm с
държач за макро касети);

Ретракция на пробата ръчно 5 - 100 микрона през стъпка
от 5 микрона с възможност за
изключване

моторизирано 10 - 70 микрона
през стъпка от 5 микрона с
възможност за изключване

Скорост на придвижване 0 – 2400 $\mu\text{m/s}$

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ.

При интерес от участие в настоящата обществена поръчка, съответният участник може да подаде оферта за изпълнение на цялата поръчка.

Офертата се подава в непрозрачен запечатан плик в рамките на определения в публичната покана краен срок. Върху плика с офертата трябва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за кореспонденция.

Срокът на валидност на офертите е 30 дни от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана.

Участниците следва да представят:

1. Заявление за участие;
2. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнени по образец – оригинал;
3. Декларации- по образец;
4. Техническото и ценово предложение към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред Възложителя представителните си функции.

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ



Приложение № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**За участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 с предмет
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Закупуване на оборудване за хистологични лаборатории“**

От АКВАХИМ АД /наименование на участника по съдебна регистрация/

БГЛС 200904064

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

вх.4, ет. 6, ап.36, в качеството си на Изпълнителен директор и Председател на СД на участника АКВАХИМ АД,

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.


След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, ние удостоверяваме, че представявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Предлаганите от нас изделия отговарят на ЗМИ, БДС, Европейските стандарти за качество или еквивалентни и ще бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставката, на всеки етап от изпълнението на договора. Разбираме и приемаме, че всяка представена от нас неточна или непълна информация, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Нашето предложение е, както следва:

1. доставяме: Система за пречистване на вода O-MAXI


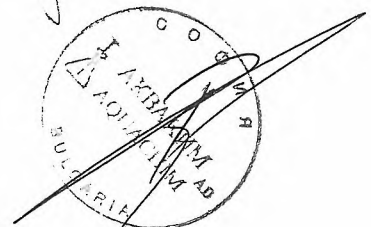


София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/9154 211; Факс: 02/951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

2. Прилагаме сравнителна таблица без цени, съдържаща пълно описание на предложеното от нас оборудване за установяване на съответствие с изискванията на възложителя.

3. Прилагаме: *каталог на фирма ДИАСИС с превод на български език,* / изброете какво прилагате, например: каталози, техническа документация, сертификати, декларации и др. приложими документи по наше усмотрение, на български език, изрично и красноречиво доказващи предложените параметри и тяхното съответствие със заложените от възложителя в спецификацията.
4. Декларираме, че след монтажа ще бъдат проведени приемателни изпитания.
5. Декларираме, че ще бъде проведено обучение за работа с нея на посочен от Възложителя персонал.
6. Предложеното от нас медицинско изделие не е било демонстрационно и не е рециклирано.
7. Всички части на устройствата са без дефекти и не са демооборудване.
8. Срок на доставка: 10 дни, считано от сключване на договора и направена заявка от страна на възложителя / моля съобразете срока с посочения от Възложителя /
9. Гаранционен срок на оборудването: 12 месеца.
10. Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация: 24 часа
11. Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя: 24 часа
12. Време за реакция при повикване: 24 часа
13. Време за отстраняване на повреда: 48 часа
14. Съгласни сме с определения от Възложителя срок и начин на плащане.


При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта.



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. Е-mail: pirogov@pirogov.bg

предложенията ни са обвързващи за нас и остават непроменяеми до изтичане срока на валидност на офертата, както и при евентуално сключване на договор за изпълнение – за целия срок на неговото действие.

Дата: 13.01.2020 г.
Име и фамилия: Елица Петрова Рускова Пълномощник на: Камелия Трендафилова Цанкова Изпълнителен директор и Председател на СД на Аквахим АД, съгласно Пълномощн 4301 от 02.12.2019 г., заверено от Нели Каракашева помощник – нотариус по заместване при Ваня Карасанова - Тончева, нотариус в район СРС, рег. № 444 на Нотар. Камара
Подпис на лицето (и печат):

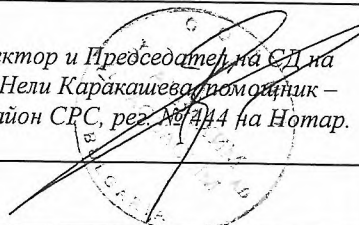






АКВАХИМ
AQUACHIM

Приложение към техническото предложение

Таблица за съответствие към техническо предложение по обособена позиция 1 „Автоматична система за почистване на вода от примеси“

Воден пречиствател O-MAXI

Техническа спецификация	Техническо предложение
Електрическо захранване – 220-230V	230 volts ~ / 50 Hz.
Производителност при 25°C минимум 30-35л	40 литра/час
Производителност при 10°C – мин. 15 л/час	Минимум 20 литра на час
Вид смола – йонообменна смола с размери -0,5 мм на частиците	Йонообменна смола с честици с размери - 0,5 мм
Обем на смолата - не повече от 0.80 литра	0.75 литра
Максимална температура на водата до 38°C	38°C
Максимална твърдост без защита - 40 °f de TH	40 °f de TH
Допустимо рН от 3-10	3 до 11
Min/max налягане	2/6 bars
Електропроводимост	≤ 1 μS
Възможност за работа на мембраната с ниско налягане, проектирано за работа без промиване	Мембрана проектирано за работа без промиване с ниско налягане
Система за работа с мембрана за обратна осмоза с проводимост 300GPD	с мембрана за обратна осмоза с проводимост 300GPD

Дата: 13.01.2020 г.

Име и фамилия: Елица Петрова Рускова

Пълномощник на: Камелия Трендафилова Цанкова - Изпълнителен директор и Председател на СД на Аквахим АД, съгласно Пълномощн 4301 от 02.12.2019 г., заверено от Нели Каракашева, помощник – нотариус по заместване при Ваня Карасанова - Тончева, нотариус в район СРС, рег. № 44 на Плотар. Камара

Подпис на лицето (и печат):

1582 София
Дружба - 2
бул. "Проф. Цветан Лазаров" 83

1582 Sofia
Druzha - 2
83, Prof. Tzvetan Lazarov Blvd.

+ 359 2 807 50 00
+ 359 2 807 50 50
e-mail: aquachim@aquachim.bg

Приложение № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 с предмет за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Закупуване на оборудване за хистологични лаборатории“

От АКВАХИМ АД /наименование на участника по съдебна регистрация/

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

вл.ч, ст. 0, ал.00, в качеството си на изпълнителен директор и Председател на СД на участника АКВАХИМ АД,

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, ние удостоверяваме, че представявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Предлаганите от нас изделия отговарят на ЗМИ, БДС, Европейските стандарти за качество или еквивалентни и ще бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.


Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставката, на всеки етап от изпълнението на договора. Разбираме и приемаме, че всяка представена от нас неточна или непълна информация, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Нашето предложение е, както следва:

1. Доставяме: Автоматизирана система за екстракция на нуклеинови киселини **ExiPrep™16 Dx** на фирма **Bioneer, Р. Южна Корея**.

2. Прилагаме сравнителна таблица без цени, съдържаща пълно описание на предложеното от нас оборудване за установяване на съответствие с изискванията на възложителя.

3. Прилагаме: *техническа документация с превод на български език и линк към продукта от страницата на фирма Байониър: <https://eng.bioneer.com/20-a->*

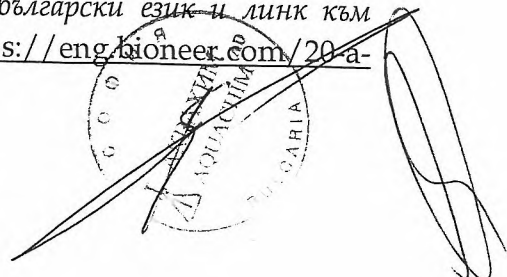

София 1606. р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/9154 211 ; Факс:/02/951 6268. E-mail:pirogov@pirogov.bg

[5050.html](#) , /изброете какво прилагате, например: каталози, техническа документация, сертификати, декларации и др. приложими документи по наше усмотрение, на български език, изрично и красноречиво доказващи предложените параметри и тяхното съответствие със заложените от възложителя в спецификацията.

4. Декларираме, че след монтажа ще бъдат проведени приемателни изпитания.
5. Декларираме, че ще бъде проведено обучение за работа с нея на посочен от Възложителя персонал.
6. Предложеното от нас медицинско изделие не е било демонстрационно и не е рециклирано.
7. Всички части на устройствата са без дефекти и не са демооборудване.
8. Срок на доставка: 10 дни, считано от сключване на договора и направена заявка от страна на възложителя / моля съобразете срока с посочения от Възложителя/
9. Гаранционен срок на оборудването: 12 месеца.
10. Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация: 72 часа
11. Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя: 48 часа
12. Време за реакция при повикване: 48 часа
13. Време за отстраняване на повреда: 48 часа
14. Съгласни сме с определения от Възложителя срок и начин на плащане.

При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта.


предложенията ни са обвързващи за нас и остават непроменяеми до изтичане срока на валидност на офертата, както и при евентуално сключване на договор за изпълнение – за целия срок на неговото действие.


Дата: 13.01.2020 г.

Име и фамилия: Елица Петрова Рускова

Пълномощник на: Камелия Трендафилова Цанкова Изпълнителен директор и Председател на СД на Аквахим АД, съгласно Пълномощн 4301 от 02.12.2019 г., заверено от Нели Каракашева, помощник – нотариус по заместване при Ваня Карасанова - Тончева, нотариус в район СРБ, рег. № 444 на Нотар. Камара

Подпис на лицето (и печат):

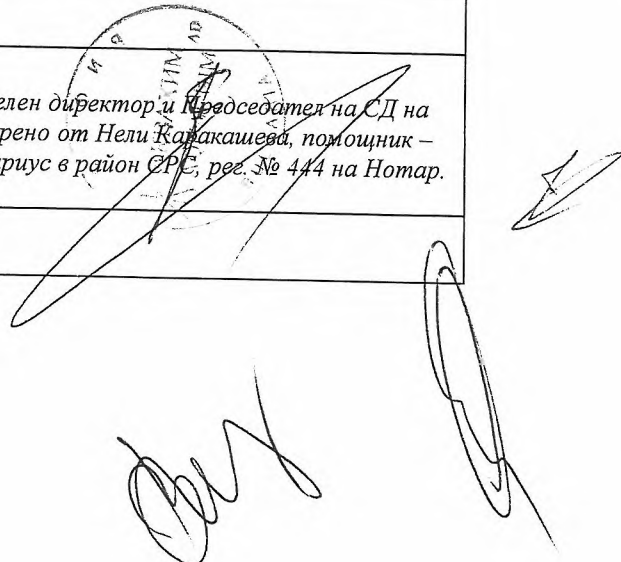



АКВАХИМ
AQUACHIM

Приложение към техническото предложение

Таблица за съответствие към техническо предложение по обособена позиция 2 Автоматизирана система за екстракция на нуклеинови киселини

Техническа спецификация	Техническо предложение
Модул за пречистване и извличане на нуклеинови киселини от различни клинични проби, включително пълна кръв, серум, плазма, тампони, урина и др към апарат EXICYCLER96	Система за извличане и пречистване на ДНК или РНК от клинични проби - пълна кръв, серум, плазма, тампони, урина и др. към апарат EXICYCLER96
Капацитет – до 16 проби	Обработка от 1 до 16 клинични проби едновременно с предварително програмирани протоколи за получаване на възпроизводим резултати
Температурен диапазон – 15 -30°C	15-30°C обхват за работа с клинични проби
Диапазон на влажност минимум 20-70%	Работа при 20-80% влажност без конденз
Възможност за UV стерилизация	15 минути цикъл
Нагриване на блока – минимум 40-85 °C	Нагриване на блока в температурен обхват от 40 до 90 °C
Охлаждане на блока при 6°C	Наличие на охлаждане на блока при 6°C
Допълнителен софтуер, съвместим за свързване и работа с EXICYCLER96	Оперативен софтуер за връзка с Exicycler96
Наличие на графичен LCD сензорен дисплей	LCD сензорен дисплей
Входно напрежение 220-240 VAC	240VAC, 50/60 Hz

Дата: 13.01.2020 г.

Име и фамилия: Елица Петрова Рускова

Пълномощник на: Камелия Трендафилова Цанкова Изпълнителен директор и Председател на СД на Аквахим АД, съгласно Пълномощие № 4301 от 02.12.2019 заверено от Нели Каракашева, помощник – нотариус по заместване при Ваня Карасанова - Тончева, нотариус в район СРС, рег. № 444 на Нотар. Камара

Подпис на лицето (и печат):

Приложение № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 с предмет
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Закупуване на оборудване за хистологични лаборатории“

От АКВАХИМ АД /наименование на участника по съдебна регистрация/

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

Д-р. Иван Георгиев, ул. „Тотлебен“, вх.4, ет. 6, ап.36, в качеството си на Изпълнителен директор и Председател на СД на участника АКВАХИМ АД,

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.


След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, ние удостоверяваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Предлаганите от нас изделия отговарят на ЗМИ, БДС, Европейските стандарти за качество или еквивалентни и ще бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставката, на всеки етап от изпълнението на договора. Разбираме и приемаме, че всяка представена от нас неточна или непълна информация, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Нашето предложение е, както следва:

1. доставяме: Автоматичен универсален ротационен микротом - Автоматичен микротом Galileo AUTO серия 2. Прилагаме сравнителна таблица без цени, съдържаща пълно описание на предложеното от нас оборудване за установяване на съответствие с изискванията на възложителя.

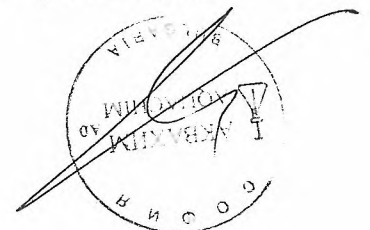

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211; Факс: 02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

3. Прилагаме: Брошура за Автоматичен микротом Galileo AUTO серия 2 на фирма ДИАПАТ с превод на български език,/ изброете какво прилагате, например: каталози, техническа документация, сертификати, декларации и др. приложими документи по наше усмотрение, на български език, изрично и красноречиво доказващи предложените параметри и тяхното съответствие със заложените от възложителя в спецификацията.
4. Декларираме, че след монтажа ще бъдат проведени приемателни изпитания.
5. Декларираме, че ще бъде проведено обучение за работа с нея на посочен от Възложителя персонал.
6. Предложеното от нас медицинско изделие не е било демонстрационно и не е рециклирано.
7. Всички части на устройствата са без дефекти и не са демооборудване.
8. Срок на доставка: 10 дни, считано от сключване на договора и направена заявка от страна на възложителя / моля съобразете срока с посочения от Възложителя/
9. Гаранционен срок на оборудването: 12 месеца.
10. Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация: 24 часа
11. Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя: 24 часа
12. Време за реакция при повикване: 24 часа
13. Време за отстраняване на повреда: 48 часа
14. Съгласни сме с определения от Възложителя срок и начин на плащане.

При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта.

предложенията ни са обвързващи за нас и остават непроменяеми до изтичане срока на валидност на офертата, както и при евентуално сключване на договор за изпълнение – за целия срок на неговото действие.

Дата: 13.01.2020 г.

Име и фамилия: Елица Петрова Рускова

Пълномощник на: Камелия Грендафиллова Данкова Изпълнителен директор и Председател на СД на Аквахим АД, съгласно Дълномощиен 4361 от 02.12.2019 г., заверено от Нели Каракашева, помощник – нотариус по заместване при Ваня Карасанова - Тончева, нотариус в район СРС, рег. № 444 на Нотар. Камара

Подпис на лицето (и печат):





АКВАХИМ
AQUACHIM


Приложение към техническото предложение

**Технически съответствия към предложението по обособена позиция 3
„Автоматичен универсален ротационен микротом“**

Автоматичен микротом Galileo AUTO серия 2

Техническите характеристики на предлагания от нас „Автоматичен универсален ротационен микротом“ Автоматичен микротом Galileo AUTO серия 2 са следните:с

- Съвременен мултифункционален микротом, който може да бъде използван в полуавтоматичен или напълно автоматичен режим на работа.
- Прецизен стъпков мотор за придвижване на пробата.
- Безопасно стартиране със задължително натискане на два бутона едновременно.
- Лесно и бързо застопоряване / заключване.
- Придвижване напред и ретракция с възможност за две скорости (Нормална и Бърза).
- Лесна и бърза настройка скоростта на рязане ((Нормална и Бърза).
- Автоматична ретракция с възможност за настройка на дебелината.
- Динамичен контрол на скоростта на рязане с помощта на прецизен педал.
- Вградена система “NHS” с противотежест за балансирано подпомагане на движението на маховика при ръчно рязане за предпазване от преумора на лаборанта.
- Държач за микротомните ножчета с вградена защита и безопасна подмяна.
- Латерално движение на държача с три зададени позиции, съобразени с размера на стандартни касети.
- Индикатор за позицията на държача в милиметри.
- Вграден LCD екран и допълнителен дистанционен контрол, който може да бъде разположен свободно в ляво или дясно за удобство на лаборанта.
- Вградена подсветка за възможна проверка качеството на среза.
- Автоматично отключване на ръкохватката за преход от ръчно към автоматично рязане.
- Ергономична ръкохватка с възможно бързо заключване във всяко едно положение за предотвратяване на инцидентно движение, което може да бъде опасно за оператора.
- Държачи за стандартни или макро касети с универсална клампа с бързо застопоряване и лесно освобождаване.
- Прецизна ориентация на спесимена с нулева позиция и регулиране от 0° до 8° .
- Поставка с антиплъзгащо покритие.
- Аварийен СТОП ключ.
- Голяма и лесна за работа тавичка за събиране на отпадъците.
- Стабилен и масивен корпус за изключително прецизна работа.
- Настройка на дебелината на срезите: 0,5 – 100 микрона обхват



АКВАХИМ
AQUACHIM

- 0.5 – 5 микрона през стъпка от 0,5 микрон
- 0.5 – 20 микрона през стъпка от 1 микрон
- 20 – 30 микрона през стъпка от 2 микрона
- 30 – 60 микрона през стъпка от 5 микрона
- 60 – 100 микрона през стъпка от 10 микрона

• Настройка дебелината на подрязване: 1 – 600 микрона обхват

- 5 – 30 микрона през стъпка от 5 микрона
- 30 – 100 микрона през стъпка от 10 микрона
- 100 – 200 микрона през стъпка от 20 микрона
- 200 – 600 микрона през стъпка от 50 микрона

- Хоризонтално придвижване 30 mm +- 1 mm, прецизен стъпков мотор
- Вертикално движение 70 mm
- Рязане тип Единично, Серийно или
- Ориентация на спесимена Продължително (при автоматична работа)
хоризонтално: 8°, вертикално: 8°,
ротация: 360°;
- Макс. Размер на спесимена (ШхД) 55 x 50 mm (68 x 50 mm с
държач за макро касети);
- Ретракция на пробата ръчно 5 - 100 микрона през стъпка
от 5 микрона с възможност за
изключване
моторизирано 10 - 70 микрона
през стъпка от 5 микрона с
възможност за изключване
- Скорост на предвижване 0 – 2400 $\mu\text{m/s}$

Дата: 13.01.2020 г.

Име и фамилия: Елица Петрова Рускова

Пълномощник на: Камелия Трендафилова Цанкова Изпълнителен директор и
Председател на СД на Аквахим АД, съгласно Пълномощн 4301 от 02.12.2019 г.,
заверено от Нели Каракашева, помощник – нотариус по заместване при Ваня
Карасанова - Тончева, нотариус в район СРС, рег. № 444 на Нотар. Камара

Подпис на лицето (и печат):

Образец № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От АКВАХИМ АД (наименование на участника)
с 200984964 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен).

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

ап.36, в качеството си на Изпълнителен директор и Председател на СД на участника АКВАХИМ АД (посочва се съответното качество на лицето), участник в при възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Закупуване на оборудване за хистологични лаборатории“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Предлагаме обща стойност в размер на **14 000.00** лева без включен ДДС или **16 800.00** лева с ДДС за Обособена позиция № 1 „Автоматична система за почистване на вода от примеси“

2. В Цената по т. 1 са включени всички разходи за изпълнение на поръчката, като възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от нас.


3. Цената, посочена в т. 1, е крайна за времето на изпълнение на поръчката и не подлежи на промяна, освен в случаите, описани в ЗОП и настоящата документация.

Дата: 13.01.2020 г.

Име и фамилия: Елица Петрова Рускова

Пълномощник на: Камелия Трендафилова Цанкова Изпълнителен директор и Председател на СД на Аквахим АД, съгласно Пълномощн 4301 от 02.12.2019 г., заверено от Нели Каракашева, помощник – нотариус по заместване при Ваня Карасанова - Тончева, нотариус в район СРС, рег. № 444 на Нотар Камара

Подпис на лицето (и печат):

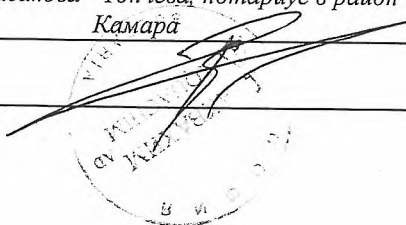

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21. Тел: 02/9154 211; Факс: 02/951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

Образец № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От АКВАХИМ АД (наименование на участника)
с 200984964 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

ап.36, в качеството си на Изпълнителен директор и Председател на СД на участника АКВАХИМ АД (посочва се съответното качество на лицето), участник в при възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Закупуване на оборудване за хистологични лаборатории“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Предлагаме обща стойност в размер на **31 000,00** лева без включен ДДС или **37 200,00** лева с ДДС за Обособена позиция № 2 Автоматизирана система за екстракция на нуклеинови киселини

2. В Цената по т. 1 са включени всички разходи за изпълнение на поръчката, като възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от нас.


3. Цената, посочена в т. 1, е крайна за времето на изпълнение на поръчката и не подлежи на промяна, освен в случаите, описани в ЗОП и настоящата документация.

Дата: 13.01.2020 г.

Име и фамилия: Елица Петрова Рускова

Пълномощник на: Камелия Трендафилова Цанкова Изпълнителен директор и Председател на СД на Аквахим АД, съгласно Пълномощн 4301 от 02.12.2019 г., заверено от Нели Каракашева, помощник – нотариус по заместване при Ваня Карасанова - Тончева, нотариус в район-СРС, рег. № 444 на Нотар. Камара

Подпис на лицето (и печат):

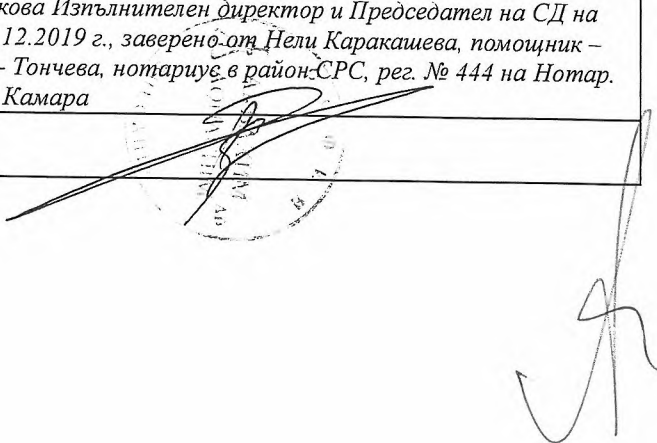

Образец № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От АКАХИМ АД (наименование на участника)
с 200984964 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

...булевард „Тотлебен“ № 21, София, ж.к. „Пирогов“, бл. 110, вл. 0, ет. 0,
ап.36, в качеството си на Изпълнителен директор и Председател на СД на
участника АКВАХИМ АД (посочва се съответното качество на лицето), участник в
при възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Закупуване на оборудване за хистологични лаборатории“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Предлагаме обща стойност в размер на **21 000.00** лева без включен ДДС или
25 200.00 лева с ДДС за Обособена позиция № 3 „Автоматичен универсален
ротационен микротом“

2. В Цената по т. 1 са включени всички разходи за изпълнение на поръчката,
като възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски,
направени от нас.

3. Цената, посочена в т. 1, е крайна за времето на изпълнение на поръчката и
не подлежи на промяна, освен в случаите, описани в ЗОП и настоящата
документация.

Дата: 13.01.2020 г.

Име и фамилия: Елица Петрова Рускова

Пълномощник на: Камелия Трендафилова Цанкова Изпълнителен директор и Председател на СД на
Аквахим АД, съгласно Пълномощн 4301 от 02.12.2019 г., заверено от Нели Каракашева, помощник –
нотариус по заместване при Ваня Карасанова - Тончева, нотариус в район СРС, рег. № 444 на Нотар
Камара

Подпис на лицето (и печат):

